

# Kit Endoguide +

Registro Anvisa N°. 82209520032

O Kit ENDOGUIDE + é um conjunto de instrumentos composto por um guia percutâneo em nitinol e uma Ponteira de Plasma Frio Bipolar. Este conjunto auxilia nos procedimentos da coluna vertebral por acesso minimamente invasivo através da técnica endoscópica Biportal (UBE). O Guia percutâneo permite um acesso preciso para o procedimento endoscópico enquanto que a Ponteira de Plasma Frio Bipolar permite realizar com segurança, procedimentos como a dissecação, retração, coagulação e a vaporização dos tecidos moles e durante o acesso endoscópico além da dissolução e vaporização do disco intervertebral de forma segura e precisa.



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)



ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit B-SCOPE

Registro Anvisa N°. 82209520308

Com Kit B-SCOPE você trata patologias da coluna vertebral de forma minimamente invasiva, segura, rápida e eficaz. O sistema permite o acesso endoscópico e de instrumentos na coluna de forma livre e com movimentos de independentes. O procedimento é realizado por meio de duas pequenas incisões (+5 a 8mm), sendo muito menos invasivo quando comparado a cirurgia aberta em comparação. Possibilita um o implante de dispositivos intersomáticos com auxílio de visão endoscópica, sem alterar as características minimamente invasivas do procedimento.



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# B-VIEW

Registro Anvisa N°. 82209520311

O Kit B-VIEW fornece os instrumentais necessários para um procedimento endoscópico seguro. O sistema permite o acesso endoscópico da coluna por via Biportal, garantindo um procedimento mais avançado. O procedimento Biportal permite um procedimento menos agressivo, através de apenas duas pequenas incisões (15 a 8mm). A técnica Biportal permite realizar procedimentos complexos de forma menos invasiva como artrodeses intersomáticas.



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# B-ACCESS

Registro Anvisa N°. 82209529319

O kit B-ACCESS é indicado para realizar promover o acesso cirúrgico endoscópico em procedimentos minimamente invasivos da coluna vertebral pela técnica cirúrgica Biportal. O procedimento é realizado através de duas pequenas incisões na pele (± 5 a 8mm) , onde são inseridos um trocater e uma pequena cânula a fim de permitir o acesso minimamente invasivo de instrumentos cirúrgicos e de um endoscópio na coluna vertebral a fim de tratar patologias da coluna vertebral. Os componentes do kit são empregados para atuar em conjunto com outros dispositivos e instrumentos endoscópicos a fim de criar uma via de acesso cirúrgico minimizado destinado a realizar o tratamento das patologias da coluna vertebral.



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Neuroflex NMX+


Registro Anvisa N°. 82209520045

Esse produto é indicado para coagulação e hemostasia de tecidos moles em procedimentos cirúrgicos, e coluna vertebral. Sua tecnologia permite transferir a energia elétrica de geradores eletrocirúrgicos para o tecido alvo (eletrocirurgia bipolar) de forma a obter o efeito desejado durante cirurgias abertas e minimamente invasivas. É também utilizado na coagulação bipolar, onde a coagulação do tecido é necessária.

## Composição:

1 Cânula Bipolar Mardflex 3,1mm x 390mm

1 Cânula de Punção 200 mm x 18 G

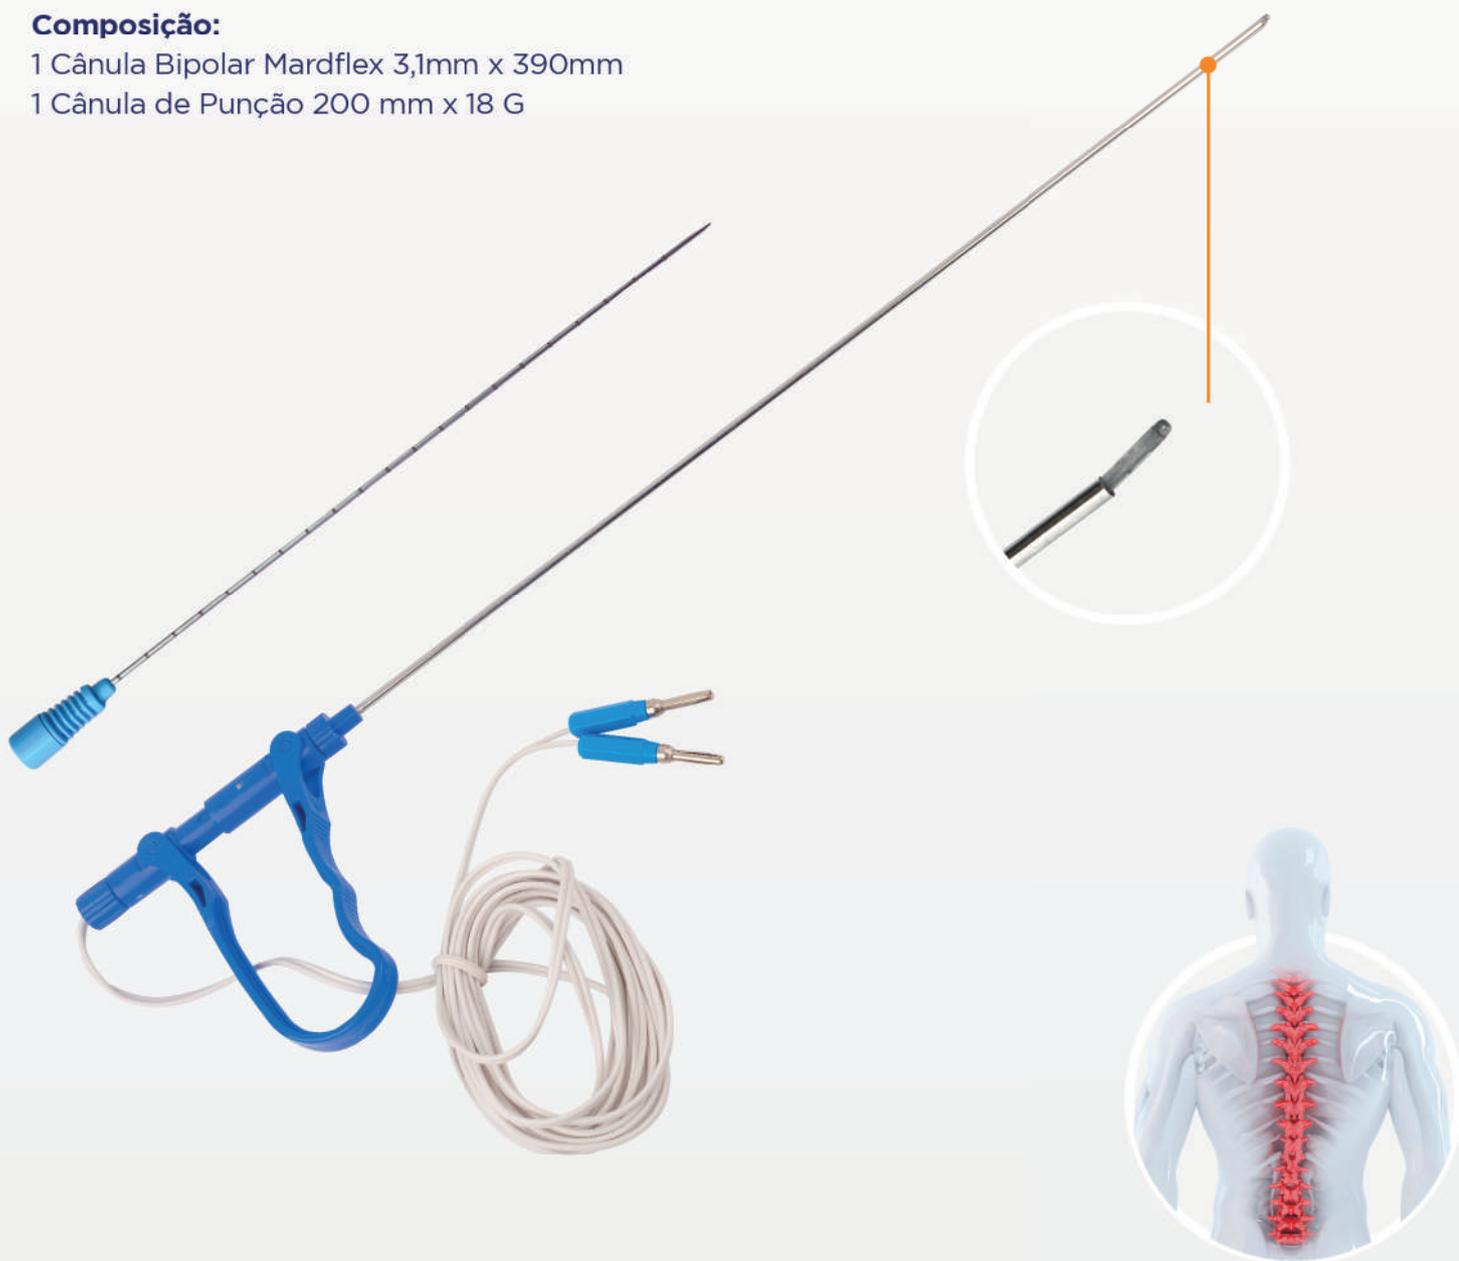

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O N O V O D E N O V O

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cânula Bipolar Mard-Flex Twist 360 com Aspiração

Registro Anvisa: 82209520044

O Kit Cânula Bipolar Mard-Flex Twist 360 com Aspiração, é um eletrodo bipolar que após introduzido no endoscópio pode ser sua ponta direcionada(girada) mecanicamente com um dispositivo atrás do cabo(direcionador) facilitando a movimentação da ponta da mesma, sem a necessidade do cirurgião "girar" a mão com a pinça para retirada de fragmentos. Além de melhorar a ergonomia para o cirurgião, o dispositivo faz com que esse direcionamento da ponta seja muito preciso. A pinça contém uma saída lateral próximo ao seu cabo, e devido a ser canulada, esses pequenos fragmentos podem ser sugados por um aspirador do hospital (ou outro aspirador qualquer, objeto de outro registro) para biópsia.



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Scraper Duo Marden +

Registro Anvisa N°. 82209520037

Fornece um instrumental para a cirurgia minimamente invasiva indicada para pacientes com doenças degenerativas de disco, como a hérnia de disco ou protusão discal e por técnica endoscópica percutânea. O kit descompressão da raiz nervosa e alívio da dor. Elimina a descompressão da medula eliminando a causa da dor.



## Composição do Kit

- 1 Cânula de Punção e Acesso 18G x 200 mm
- 1 Fio Guia de Nitinol 1mm x 400 mm
- 1 Lâmina de Coluna BD Ø3.5 x 330 mm
- 1 Lâmina de Coluna BR Ø3.5 x 330 mm
- 1 Equipo de Irrigação de 4 vias
- 1 Cânula Bipolar Mard-flex



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Scraper Fast Marden +

Registro Anvisa N°. 82209520030

Fornece um instrumental para a cirurgia minimamente invasiva indicada para pacientes com doenças degenerativas de disco, como a hérnia de disco ou protusão discal e por técnica endoscópica percutânea. O kit descompressão da raiz nervosa e alívio da dor. Elimina a descompressão da medula eliminando a causa da dor.



## Composição do Kit

- 1 Cânula de Punção e Acesso 18G x 200 mm
- 1 Fio Guia de Nitinol 1mm x 400 mm
- 1 Lâmina de Coluna BD Ø3.5 x 330 mm
- 1 Equipo de Irrigação de 4 vias
- 1 Cânula Bipolar Mard-flex



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cânula Anuloplastia Discal Percutânea PercDisk-BP+

Registro Anvisa N°. 82209520034

Fornece um instrumental para a cirurgia minimamente invasiva indicada para pacientes com doenças degenerativas de disco, como a hérnia de disco ou protusão discal e por técnica endoscópica percutânea. O kit descompressão da raiz nervosa e alívio da dor. Elimina a descompressão da medula eliminando a causa da dor.

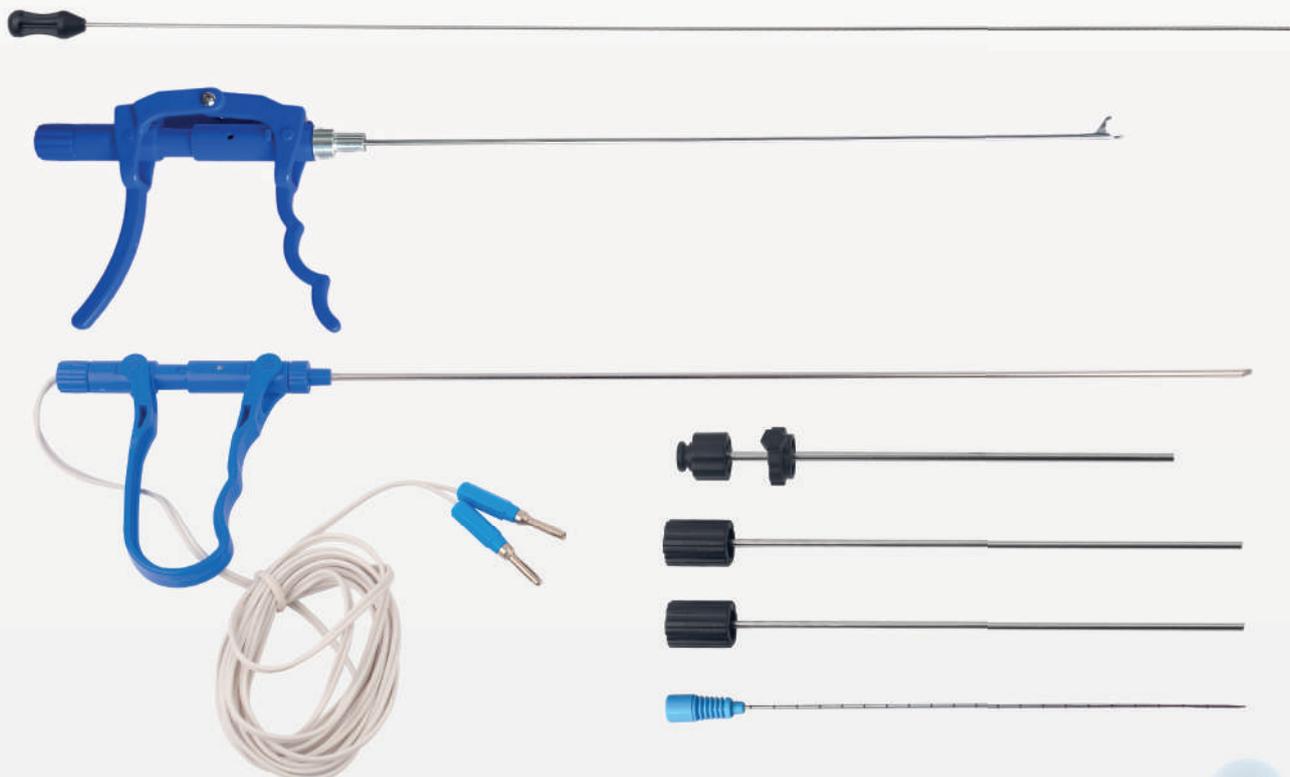

## Composição do Kit

- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1 Cânula de Punção e Acesso 18G x 200 mm | 1 Trefina 3,5mm x 185mm           |
| 1 Fio Guia de Nitinol 1mm x 400 mm       | 1 Pinça Discectomia 2,5mm x 330mm |
| 1 Trocarter 4,2mm x 165mm                | 1 Limitador/Stop                  |
| 1 Obturador 3,5mm x 185mm                | 1 Cânula Bipolar Mard-flex        |



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Pneumático Para Nucleotomia Percutânea Discal Core Xtractor

Registro Anvisa N°. 82209529045

O kit fornece um instrumental utilizado em cirurgias minimamente invasivas indicadas para pacientes com doenças degenerativas de disco, como a hérnia de disco ou a protrusão discal, na região lombar. Aplicando a técnica de discectomia percutânea, este método visa à decompressão da medula responsável por esta patologia. Com lâminas de corte pneumática, o cirurgião controla com melhor precisão, todo o processo de retirada núcleo durante o procedimento.

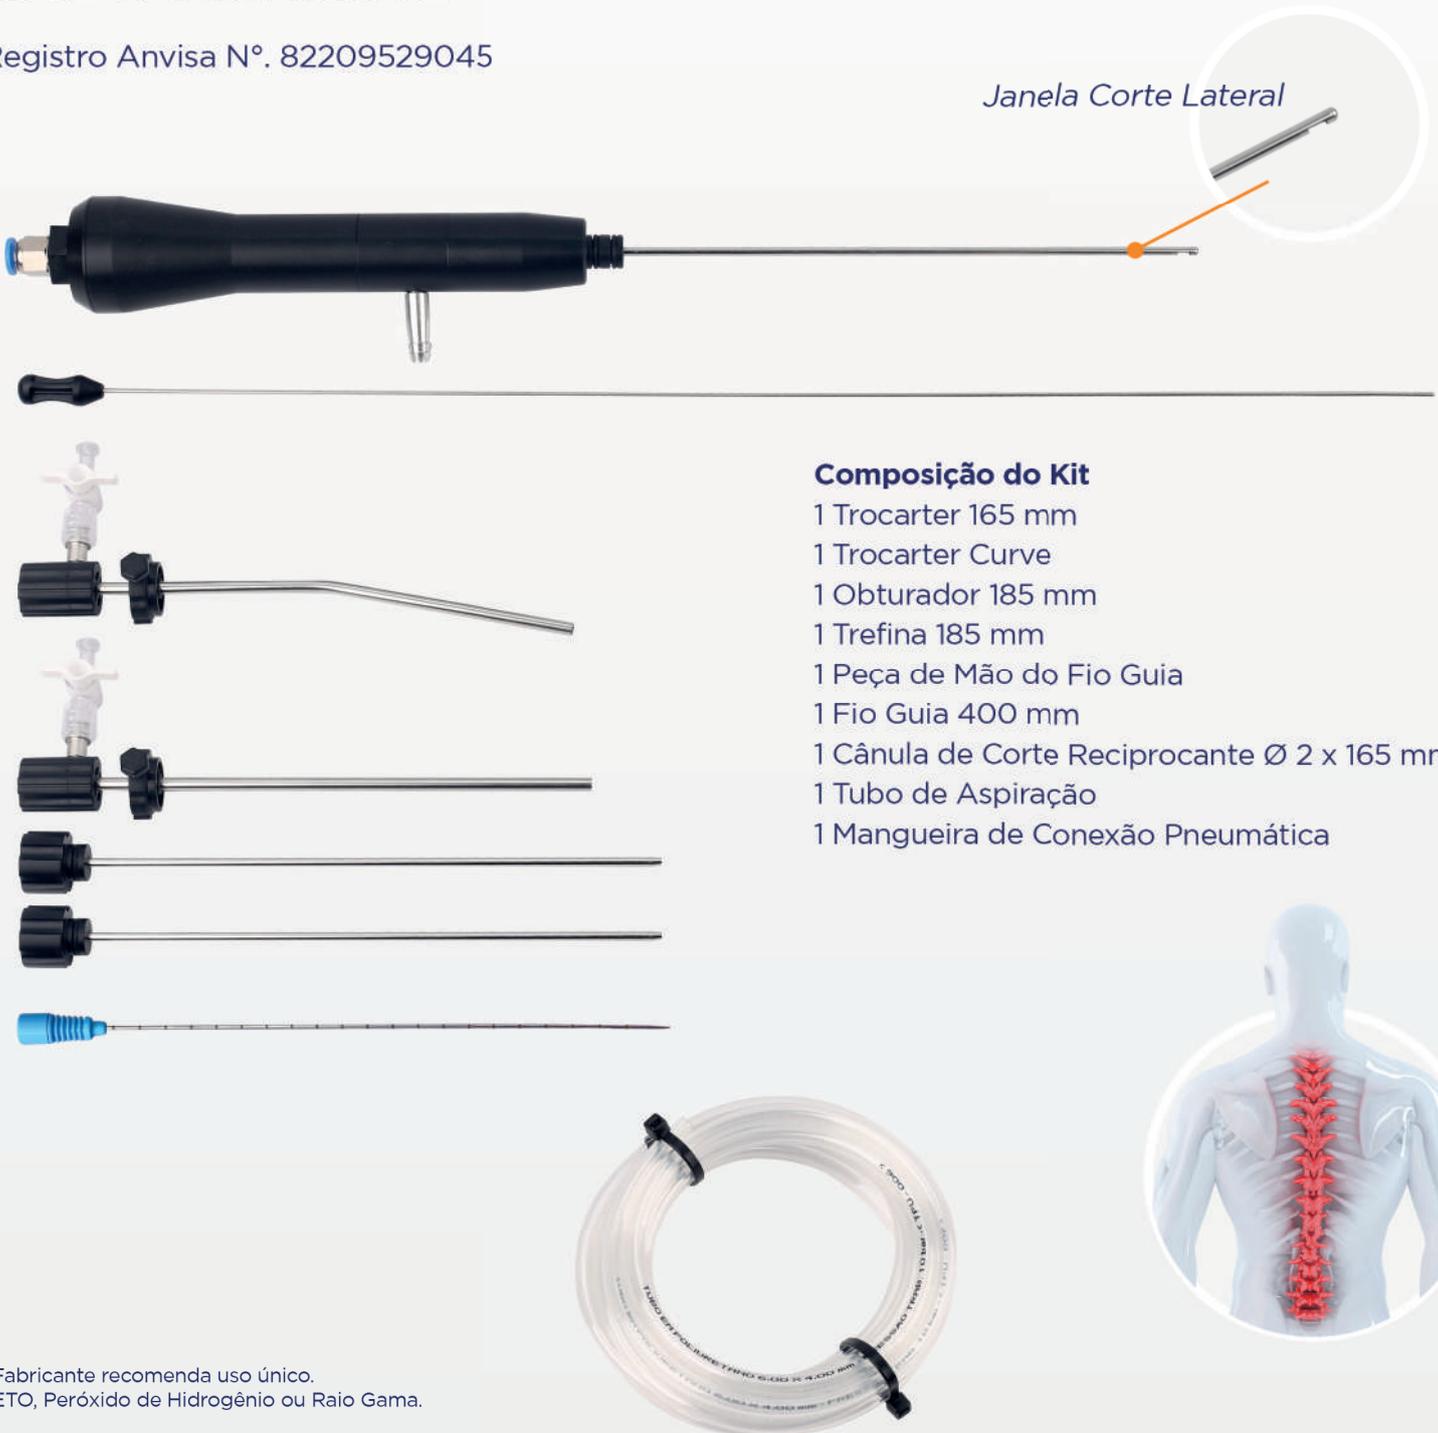

Janela Corte Lateral

## Composição do Kit

- 1 Trocarter 165 mm
- 1 Trocarter Curve
- 1 Obturador 185 mm
- 1 Trefina 185 mm
- 1 Peça de Mão do Fio Guia
- 1 Fio Guia 400 mm
- 1 Cânula de Corte Reciprocante Ø 2 x 165 mm
- 1 Tubo de Aspiração
- 1 Mangueira de Conexão Pneumática

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Nucleótomo Endoscópico Pneumático Endo Xtractor

Registro Anvisa N°. 82209529043

Este kit fornece um instrumental utilizado em cirurgias minimamente invasivas indicadas para pacientes com doenças degenerativas de disco, como a hérnia de disco ou protrusão discal, na região lombar. Aplicando a técnica de discectomia percutânea, este método visa à descompressão da raiz nervosa e o alívio da dor, eliminando assim, a descompressão da medula responsável por esta patologia. Com lâmina de corte pneumática, o cirurgião controla com melhor precisão, todo o processo de retirada do núcleo durante o procedimento.

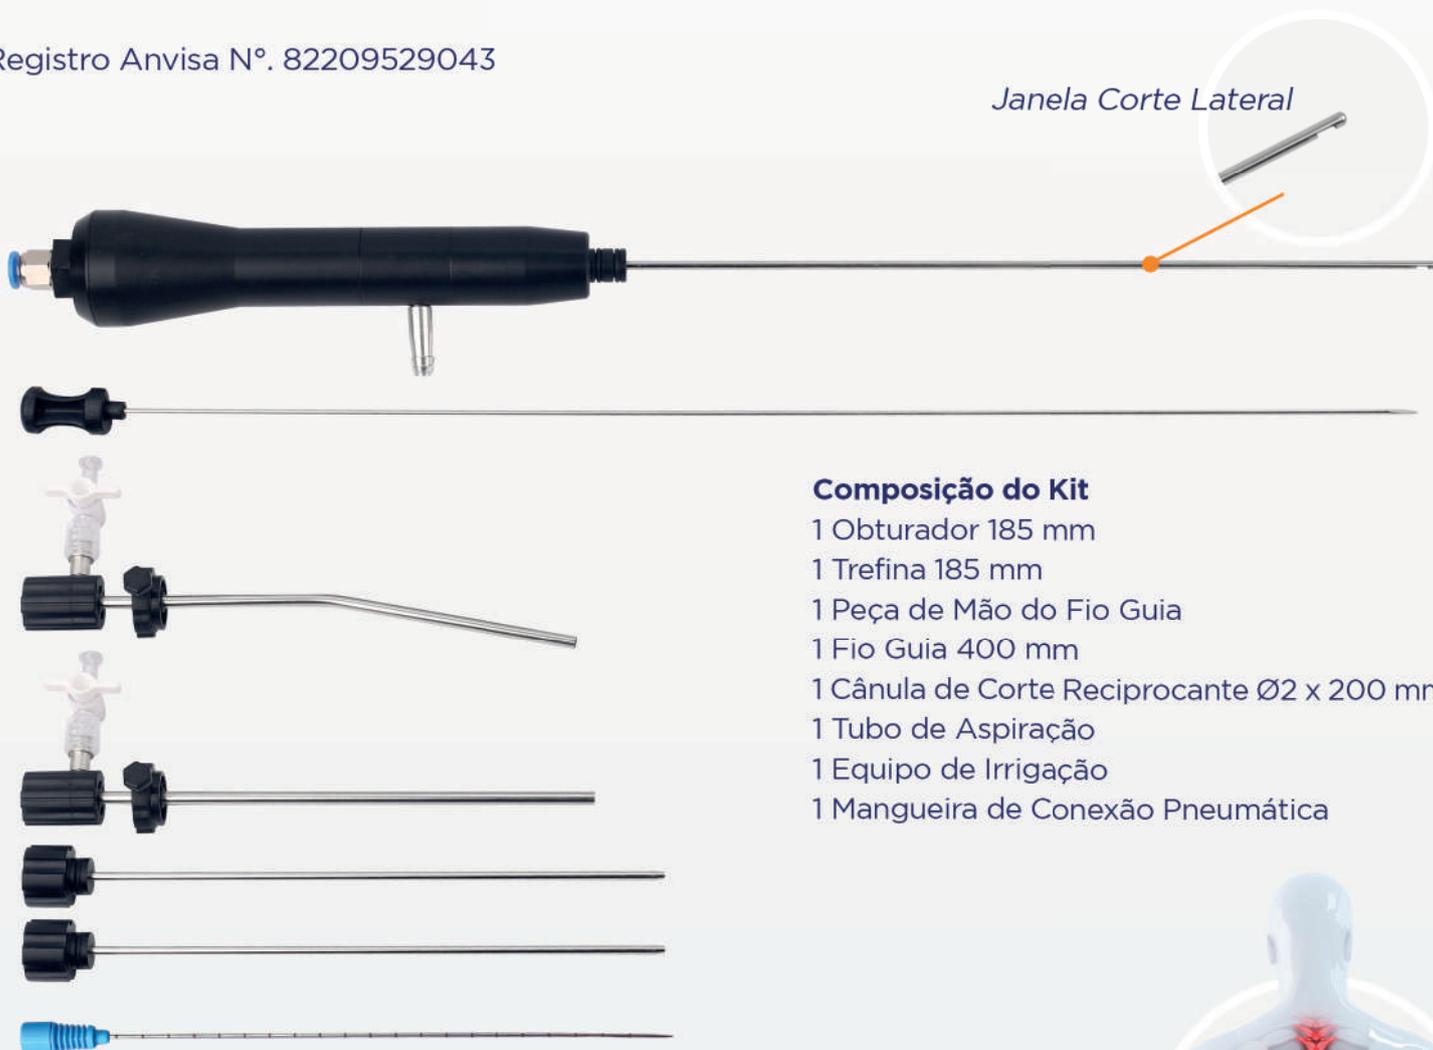

## Composição do Kit

- 1 Obturador 185 mm
- 1 Trefina 185 mm
- 1 Peça de Mão do Fio Guia
- 1 Fio Guia 400 mm
- 1 Cânula de Corte Reciprocante Ø2 x 200 mm
- 1 Tubo de Aspiração
- 1 Equipo de Irrigação
- 1 Mangueira de Conexão Pneumática

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.



**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cãnula de Discectomia Percutânea Mecãnica Discmotion

Registro Anvisa N°. 82209529259

O KIT CANULA DE DISCECTOMIA PERCUTÃNEA MECÃNICA DISCMOTION foi projetado para utilizaçãõ em cirurgias minimamente invasivas de doenças de coluna, tais como discectomias percutãnneas de disco. Sua principal característica e diferencial estã na Cãnula Handmotion Core que possibilita fazer cirurgias sem utilizaçãõ de nenhum equipamento conjugado. A cãnula de corte possui um cabo que em movimentos de fechar e abrir a mãõ, faz com que a ponta de corte da mesma gire nas duas direções, possibilitando corte e retirada de fragmentos de disco intervertebral ou fibroses com muita facilidade.

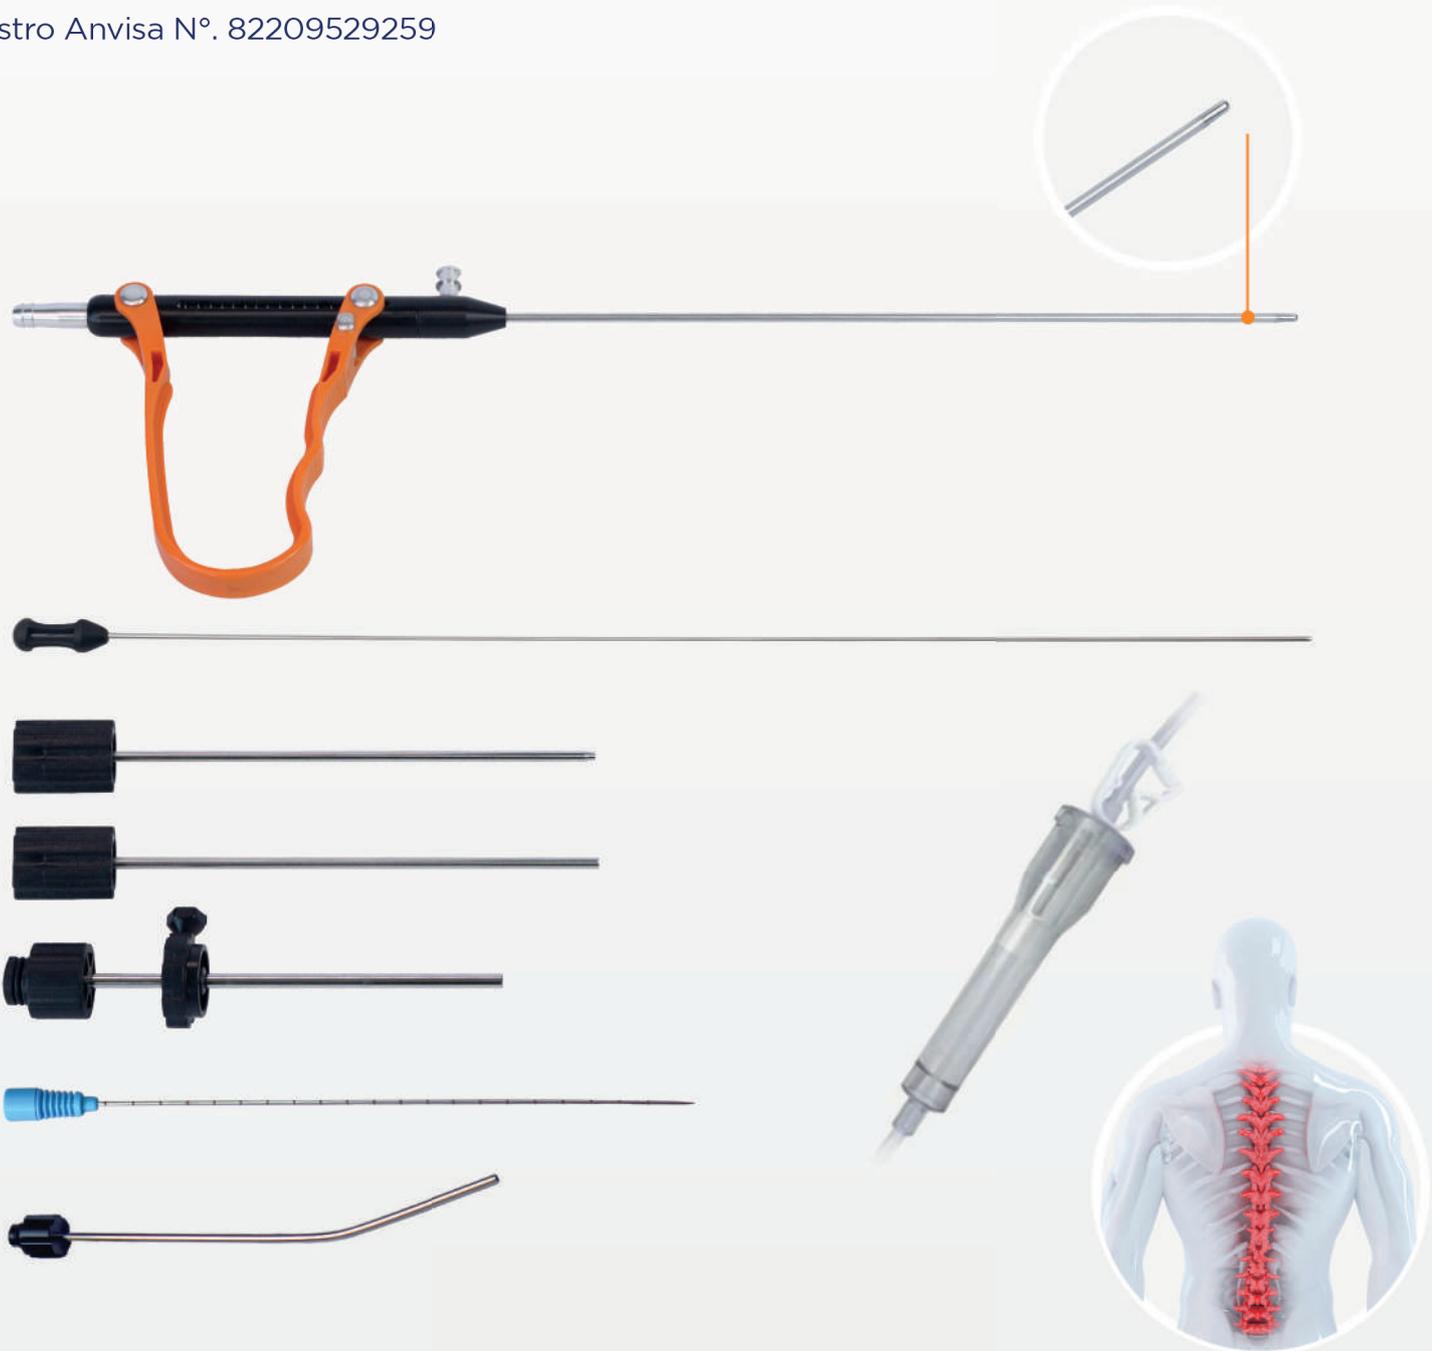

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Cânula de corte Manual com Aspiração e Irrigação Handmotion Core

Registro Anvisa N°. 82209529260

Desenvolvido para cirurgias minimamente invasivas na área da coluna, cuja característica está na possibilidade de não utilizar nenhum equipamento conjugado. A cânula possui um cabo com movimentos de fechar e abrir a mão fazendo com que a ponta de corte gire em duas direções possibilitando a retirada de fragmentos de disco intervertebral ou fibroses, com extrema facilidade. Acompanha um equipo gravitacional de irrigação para injeção de líquido no local da cirurgia para facilitar o processo de visualização, além de um tubo aspirador com coletor, que acoplado ao aspirador do centro cirúrgico, faz a sucção dos tecidos cortados pela cânula de corte.



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cânula Endoscect

Registro Anvisa N°. 82209529036

O kit fornece um instrumento utilizado em cirurgias minimamente invasivas indicadas para pacientes com doenças degenerativas de disco, como a hérnia de disco ou protusão discal na região lombar. Aplicando a técnica de discectomia percutânea, este método visa à descompressão da raiz nervosa e o alívio da dor permitindo acesso ao corpo vertebral, eliminando assim, a descompressão da medula responsável por esta patologia.

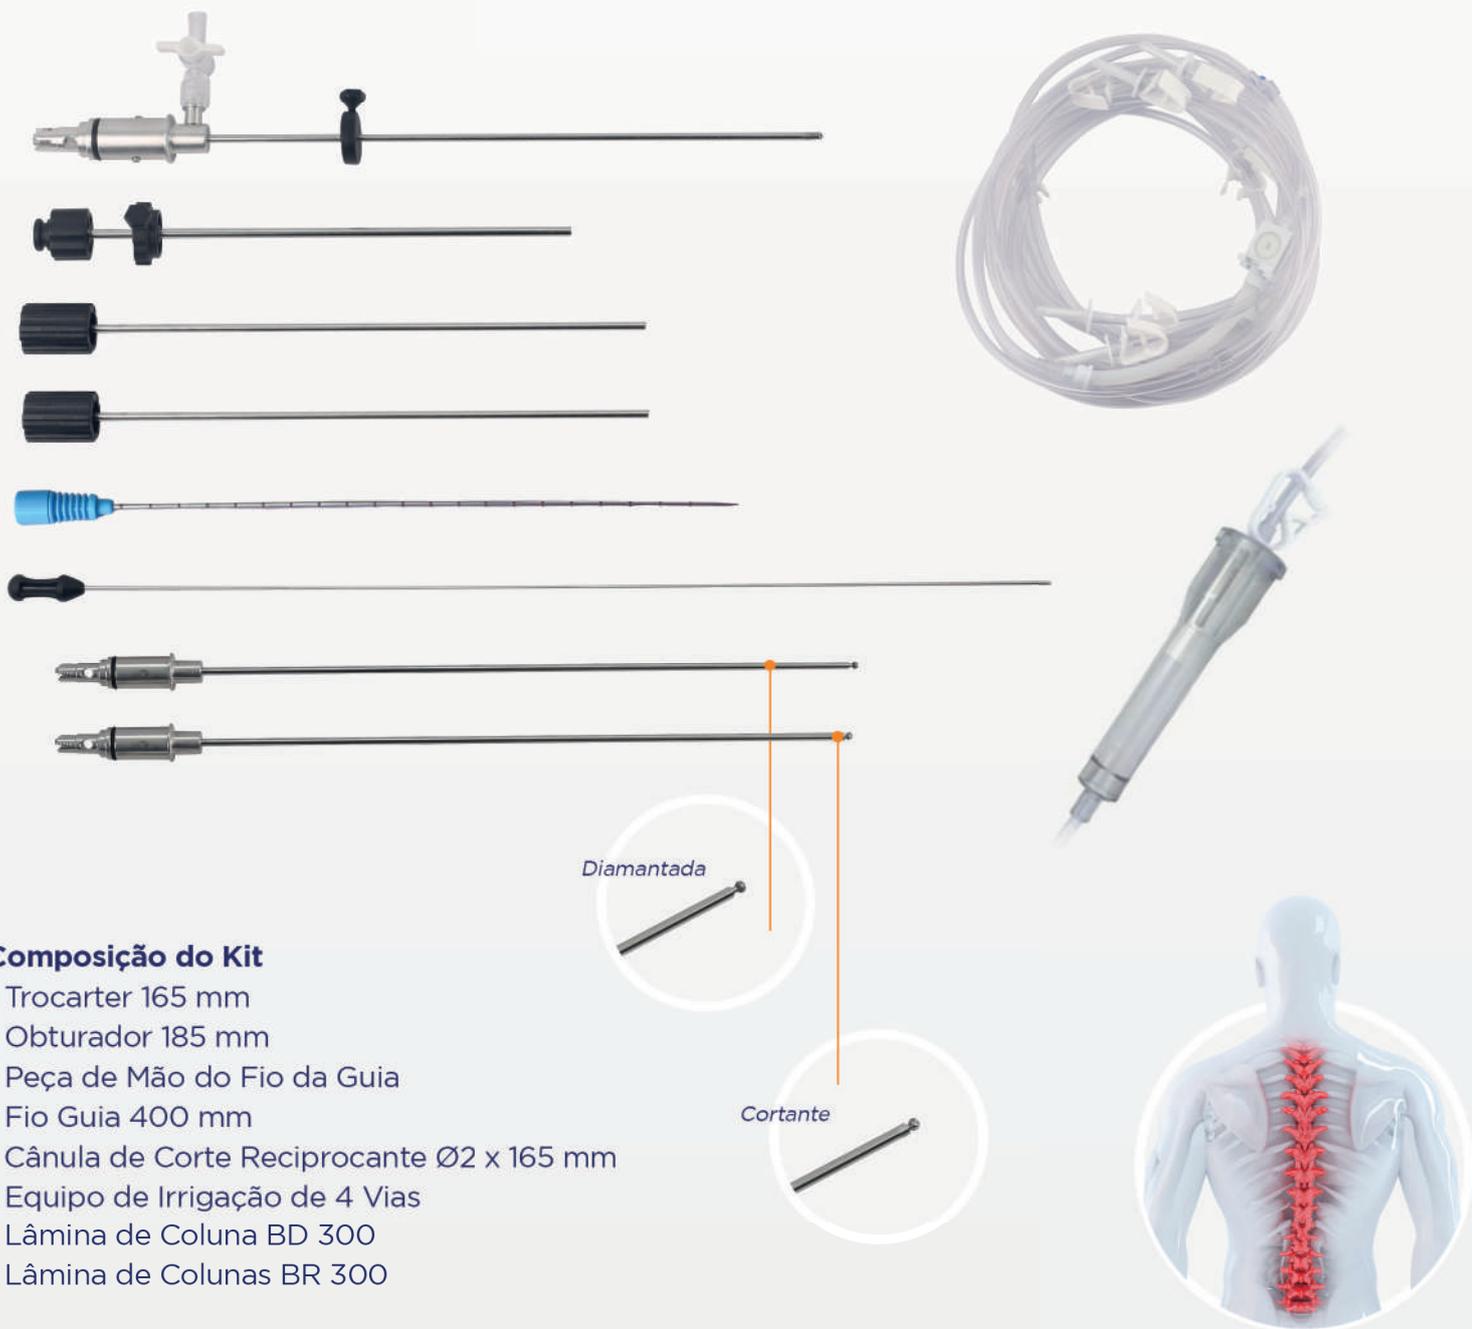

## Composição do Kit

- 1 Trocarter 165 mm
- 1 Obturador 185 mm
- 1 Peça de Mão do Fio da Guia
- 1 Fio Guia 400 mm
- 1 Cânula de Corte Reciprocante Ø2 x 165 mm
- 1 Equipo de Irrigação de 4 Vias
- 1 Lâmina de Coluna BD 300
- 1 Lâmina de Colunas BR 300

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO




# Kit Cãnula de Discectomia Percutânea de Disco Lombar

Registro Anvisa N°. 82209529005

## Composição do Kit

- 1 Cãnula de Corte Lombar
- 1 Trocarter Lombar
- 1 Obturador Lombar
- 1 Trefina Lombar
- 1 Cãnula de Punção Lombar
- 1 Tubo Aspirador com Coletor
- 1 Peça de Mão do Fio Guia

O kit fornece um instrumental eficaz utilizado em cirurgias minimamente invasiva indicada para pacientes com doenças degenerativas de disco, como hérnia de disco ou a protrusão discal para região lombar. Proporciona à descompressão da raiz nervosa e o alívio da dor utilizando a técnica de discectomia.

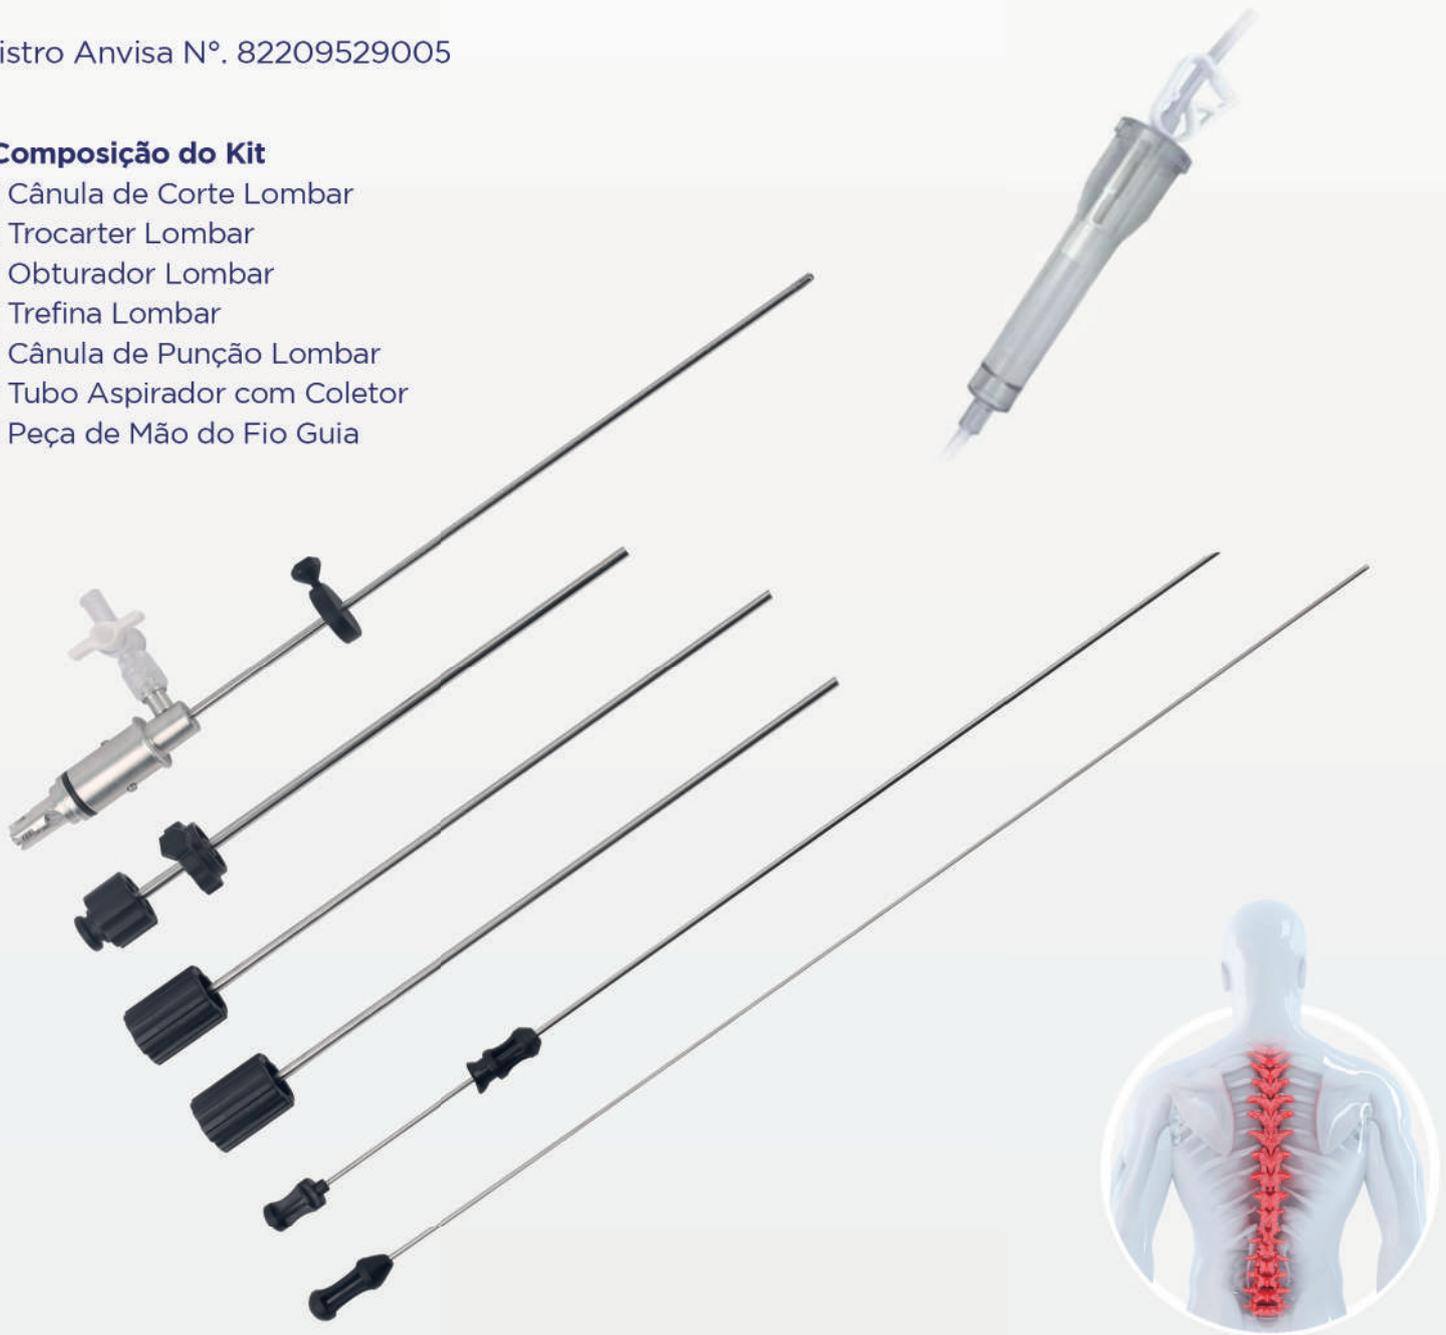

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO




# Kit Cânula de Discectomia Percutânea de Disco Cervical

Registro Anvisa N°. 82209529009

**Modelos** com cânulas compatíveis aos encaixes Linvatec, Razek, Stryker, Formula, EP1 e Setormed.

O kit fornece um instrumental eficaz utilizado em cirurgia minimamente invasiva indicado para pacientes com doenças degenerativas de disco, como a hérnia de disco ou a protrusão discal sintomática e ciática, na região cervical. Proporciona uma descompressão da raiz nervosa e o alívio da dor.

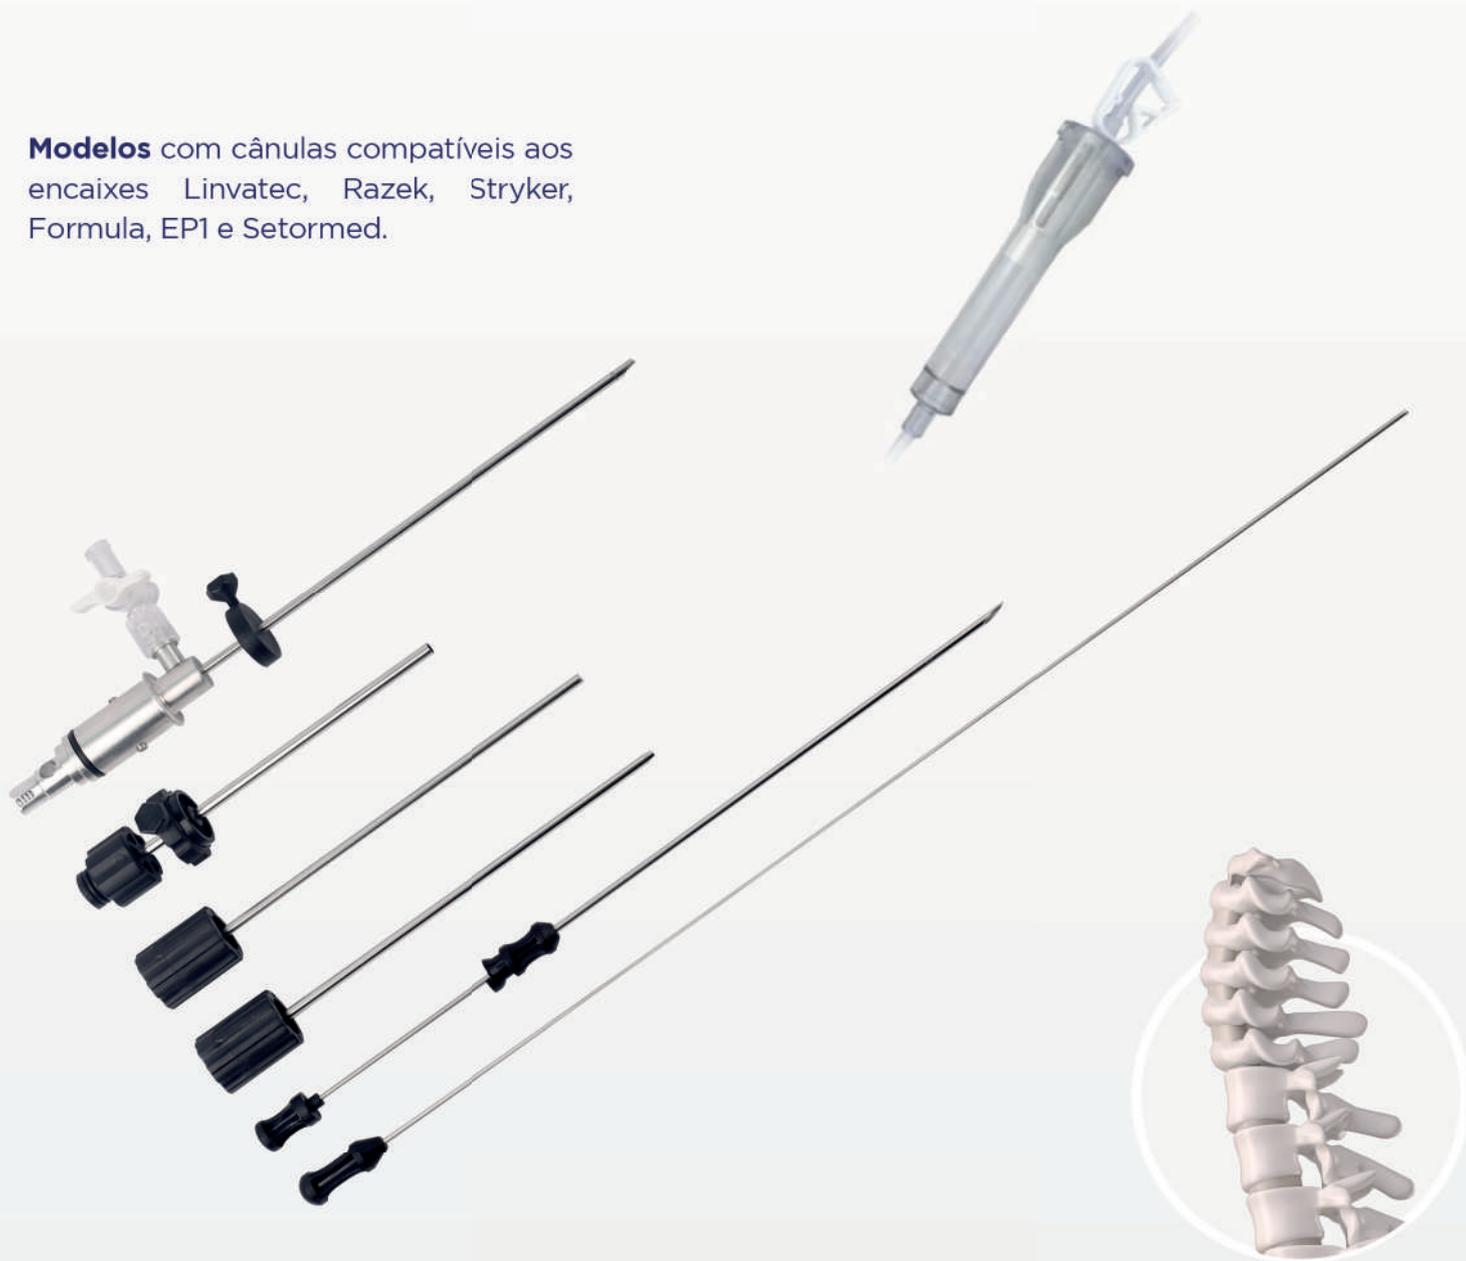

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cãnula de Descompressão de Coluna Side Core Curved

O kit fornece um conjunto de descompressão de hérnia de disco intervertebral voltado ao tratamento de protusões discais, com rompimento parcial das fibras anulares, com coletor em sistema fechado de disco e instrumentos para tratamento toracolombar.

Registro Anvisa N°. 82209529044

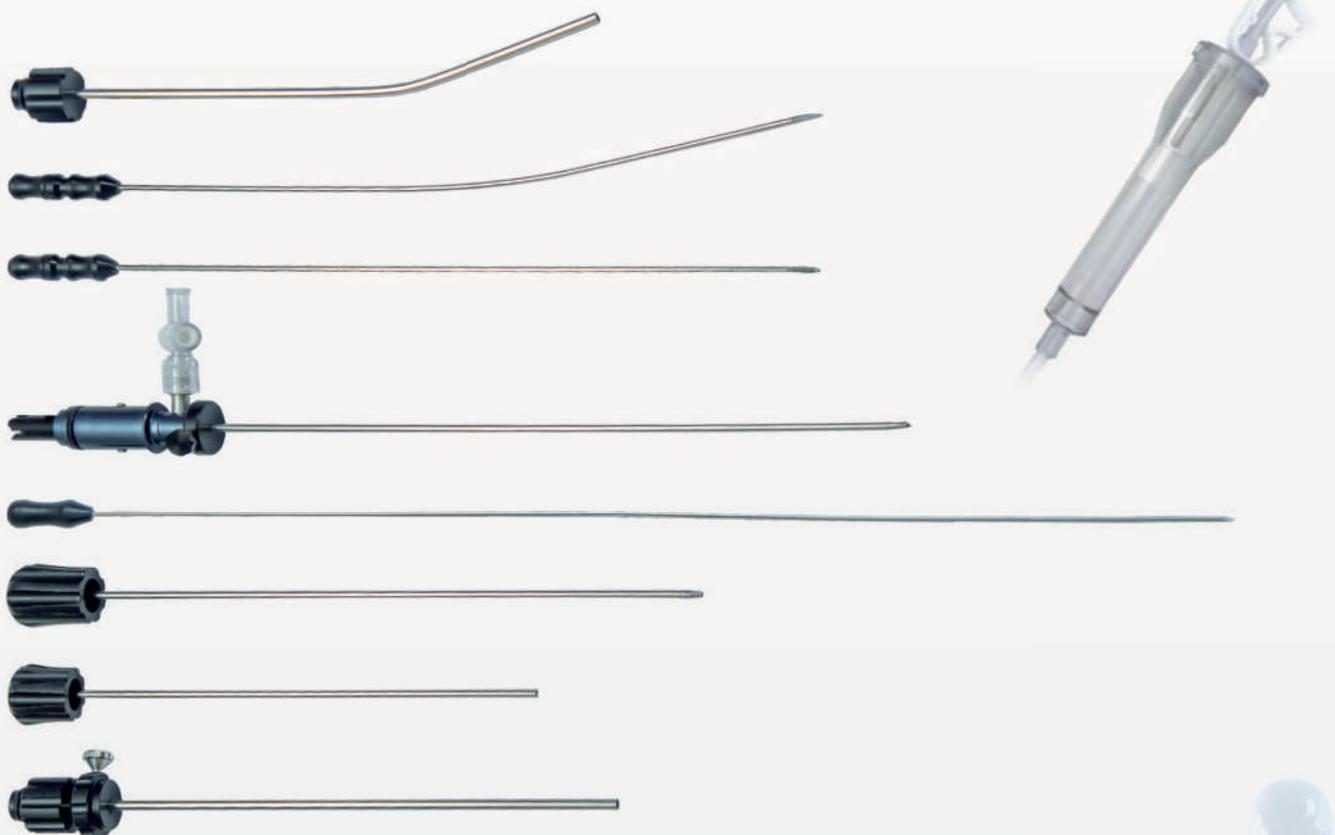

## Composição do Kit

- |  |  |
|--|--|
| 1 Cãnula de Corte Reciprocante               | 1 Cãnula de punção Lombar              |
| 1 Trocater Lombar com Limitador              | 1 Cãnula de punção Lombar Angulado 15° |
| 1 Trocater Lombar Angulado 15° com Limitador | 1 Fio guia                             |
| 1 Trefina Lombar                             | 1 Peça de mão do fio guia              |
| 1 Obturador Lombar                           |  |



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cãnula Para Acesso Percutãnneo Cervical

Este kit fornece um instrumental eficaz acessando os procedimentos de descompressão da hãrnica de disco na regiãõ cervical, por meio de uma cirurgia minimamente invasiva.

Registro Anvisa N.º. 82209520005

## Composiãõ do Kit

- 1 Trocater Cervical com Limitador
- 1 Trefina Cervical
- 1 Obturador Cervical
- 1 Cãnula de punçãõ Cervical
- 1 Fio guia
- 1 Peça de mãõ do fio guia



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cãnula Para Acesso Percutãnneo Lombar

Este kit fornece um instrumental para acesso em procedimentos de descompressão de hãrnica de disco na regiãõ lombar, por meio de uma cirurgia minimamente invasiva.

Registro Anvisa N°. 822095520001



## Composiãõ do Kit

- 1 Trocater Lombar com Limitador
- 1 Trefina Lombar
- 1 Obturador Lombar
- 1 Cãnula de punçãõ Lombar,
- 1 Fio guia
- 1 Peçã de mãõ do fio guia



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O N O V O D E N O V O

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cânula Decompression

Registro Anvisa N°. 82209529251


O produto é indicado para cirurgias minimamente invasivas para retirada de fragmentos ósseos lesionados internamente e criação de cavidades para preenchimento com biomateriais(objetos de outros registros). Pode ser utilizado em qualquer área óssea que demande acesso minimamente invasivo, com lesão óssea já existente, ou onde é necessário abertura de cavidade para preenchimento com biomateriais. Os componentes do kit descartável são fabricados pensando numa completa solução para o cirurgião. Contém instrumentos de acesso inicial, instrumentos de retiradas ósseas precisas além de cânulas possibilitadoras de aplicação de biomateriais(objetos de outros registros), tais como, enxertos e cimentos ósseos.



Escala de  
Expansão



Lâmina Expansiva

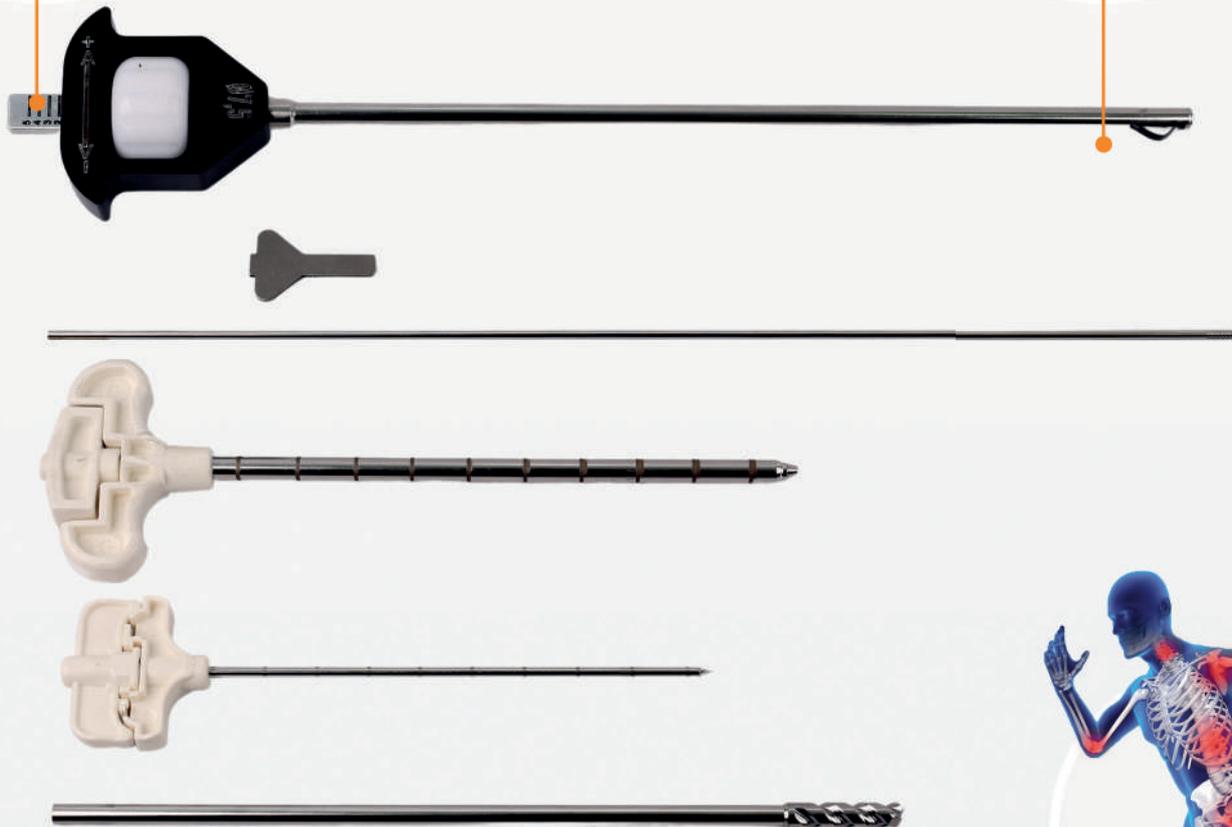

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

Produto indicado para cirurgias minimamente invasivas com a proposta de retirar fragmentos ósseos lesionados internamente ou na criação de cavidades para preenchimentos com biomateriais de outros registros.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Osteoinject Precision

Registro Anvisa N°. 82209529235

O Kit OSTEONJECT PRECISION, é projetado para fornecer uma solução abrangente em procedimentos cirúrgicos ósseos. Este kit é essencial para a aplicação de enxerto ósseo sintético em suas diversas aplicações, carreadores de antibiótico e enxerto ósseo autólogo, adaptando-se com eficácia a uma variedade de cenários clínicos.

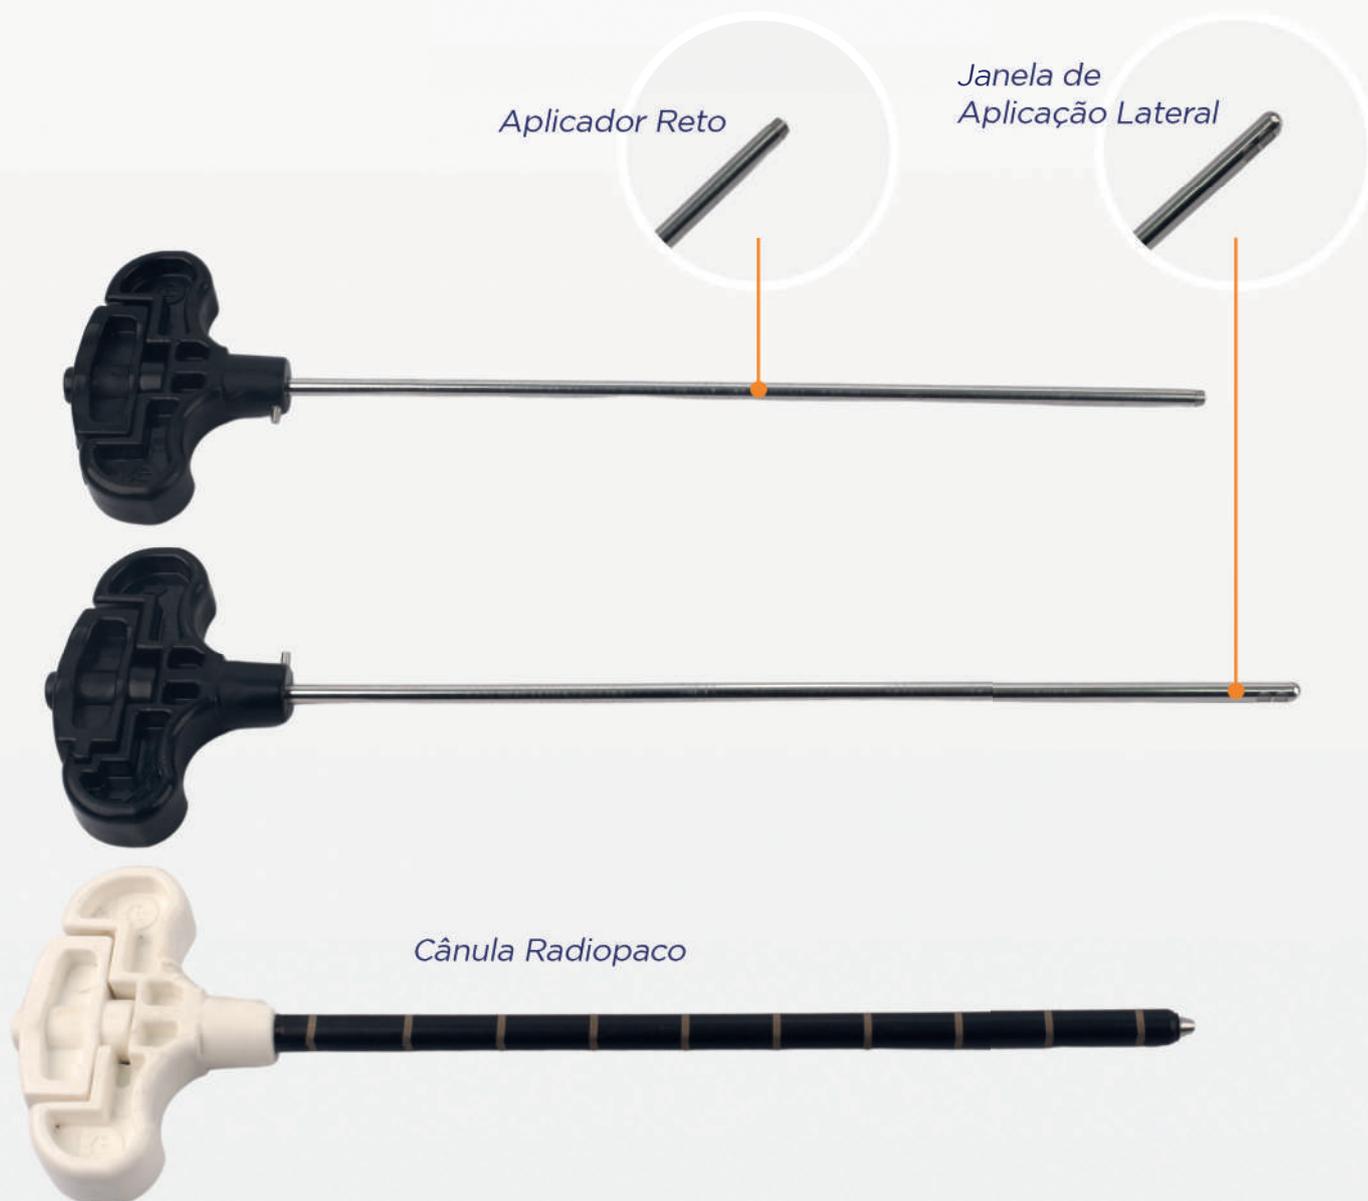

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit para Osteocondroplastia e Foragem Óssea Condروفill

Registro Anvisa Nº. 82209529257



Indicado para pacientes com doenças ósseas em diversas articulações — incluindo joelhos, quadris, ombros, cotovelos, punhos, tornozelos, sacroilíacas e até nas articulações menores dos pés e mãos, ou ainda áreas que necessitem de foragem óssea (retirada de edema interno) que apresentem cistos ou pseudocistos, ou ainda sinais de edema ósseo medular em exames de imagem, o KIT PARA OSTEOCONDROPLASTIA E FORAGEM OSSEA CONDROFILL é uma ferramenta crucial. Ele oferece aos cirurgiões um conjunto de dispositivos precisos e avançados, facilitando a mitigação da falha estrutural decorrente de articulações artrósicas.



Escala de  
Expansão



Lâmina Expansiva

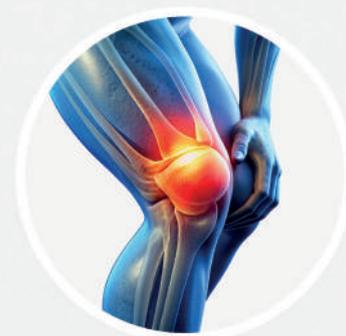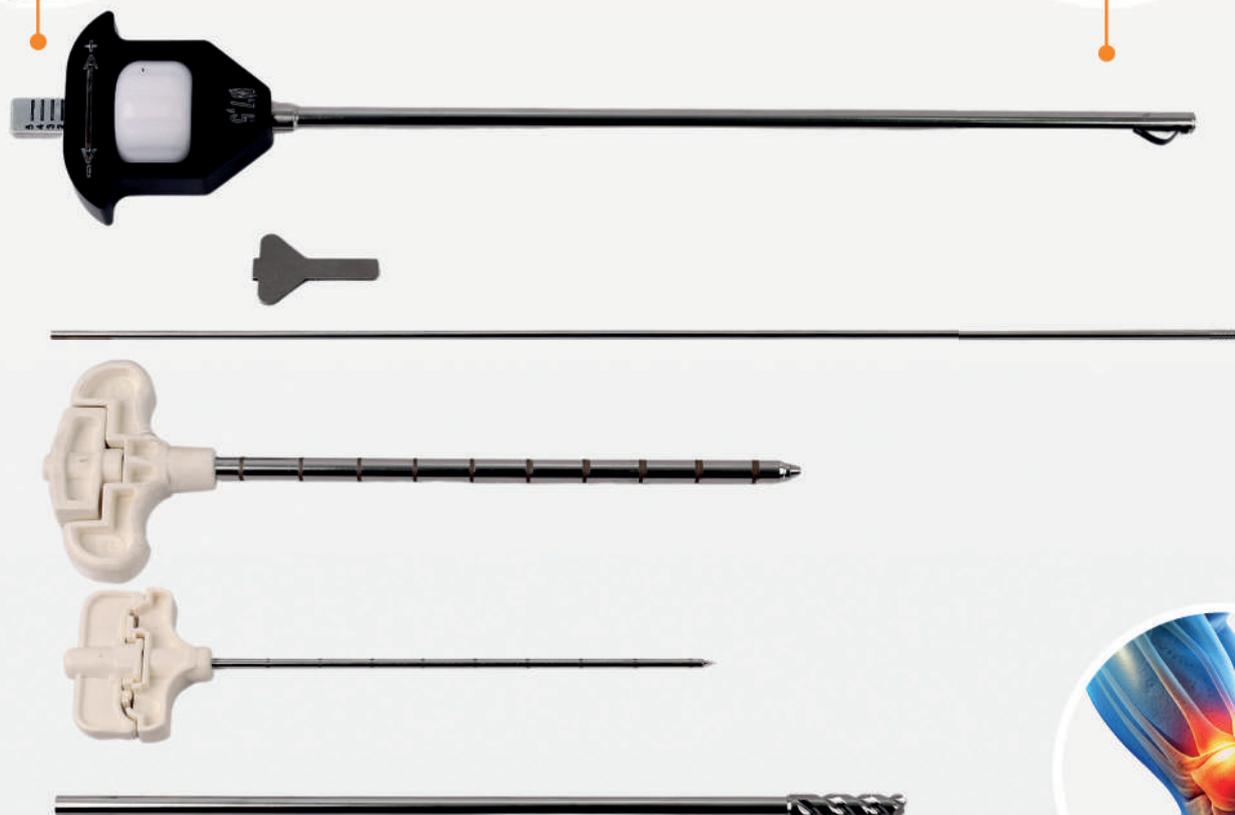

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Inside Core Evolution

Registro Anvisa N°. 82209529238

Fornece uma solução abrangente em procedimentos cirúrgicos ósseos promovendo um processo de descompressão, que auxilia na redução de fraturas articulares. Esses instrumentos foram projetados para otimizar o acesso ao local da lesão garantindo uma remoção eficaz de tecido ósseo, permitindo assim, uma aplicação de enxertos e cimentos ósseos, quando necessário.



Esse Kit é ideal para o uso em cirurgias que demandam uma abordagem cuidadosa e detalhada.

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cânula para Cirurgia de Subcondroplastia com Broca Óssea

Registro Anvisa N°. 82209529146

Este kit é utilizado nos procedimentos minimamente invasivos com o intuito de preencher lesões ósseas medulares como um substituto ósseo à base de fosfato de cálcio (objeto de outro registro). Este preenchimento auxilia no processo de recuperação clínica melhorando a dor e facilitando as atividades dos pacientes. A Subcondroplastia é um sistema guiado, através de radioscopia, cujas cânulas direcionam o processo de manipulação do cirurgião e a broca facilita o desenvolvimento da incisão.

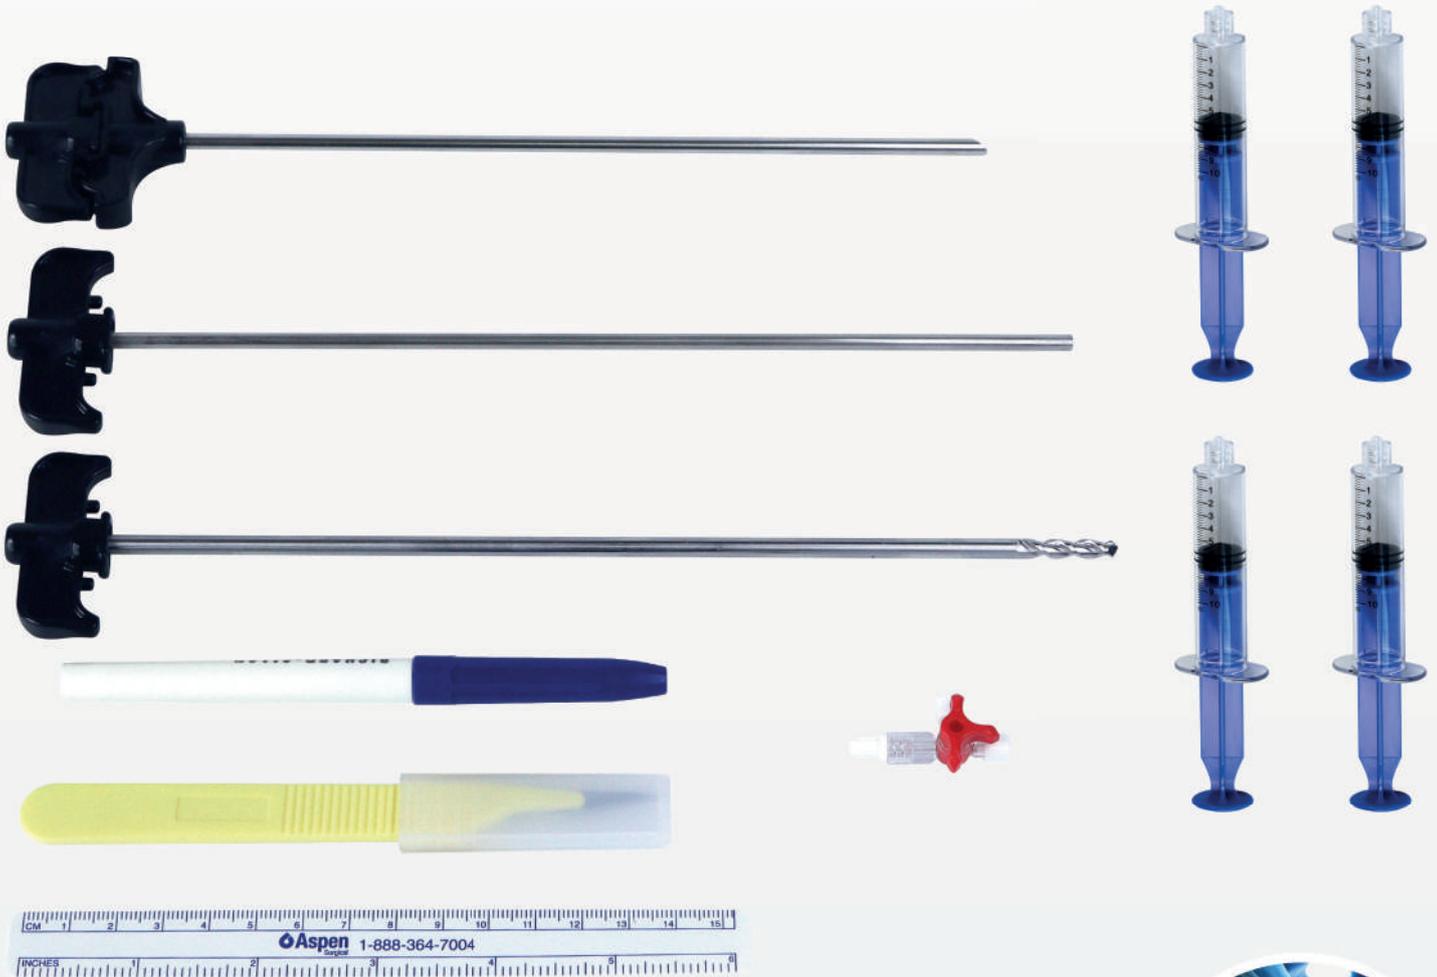

## Composição do Kit

- 1 Cânula Para Subcondroplastia Graduada com Saída Lateral Ø4,5 x 200 mm x 50°
- 1 Obturador Subcondroplastia Ø4,0 x 200 mm x 50°
- 1 Empurrador Subcondroplastia Ponta Reta Ø4,0 x 200 mm
- 1 Broca Óssea Ø4,5 x 200 mm

- 4 Aplicadores 5 ml
- 1 Conector 3 Vias
- 1 Bisturi nº 4
- 1 Caneta Marca Pele
- 1 Régua de Marcação 15 cm

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.



**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cânula Para Osteoplastia Vertebral Percutânea Bipedicular Com Bio Extrator Vertplast

Registro Anvisa N°. 82209529060

Este produto fornece um kit instrumental percutâneo eficaz para o acesso e a execução de osteoplastia e reforço do corpo vertebral, através da injeção de biomateriais (material não incluso no kit). A extração de amostras é realizada por meio do bioextrator de tecidos para análise patológica da coluna vertebral. Utiliza o procedimento de cirurgia minimamente invasiva integrado com a técnica de acesso bipedicular.



## Composição do Kit KVPL 069 001

- 2 Cânulas de Acesso VTB 11G x 100 mm
- 1 Trocarter Ø2.4 mm x 140 mm
- 1 Broca Coletora 13 G x 137 mm
- 1 Bio Extrator Ø2.35 mm x 200 mm
- 1 Bio Ejetor Ø1.7 mm x 234 mm
- 1 Aplicador com Extensor de 10 cc

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit para Osteoplastia Vertebral com Expansor Vertebral SOMATIC

Registro Anvisa N°. 82209529218

Indicado para cirurgias minimamente invasivas de correção de fraturas dos platoes vertebrais e a remoção de tecido ósseo vertebral através da curetagem rotacional, além da possibilidade de aplicações de biomateriais (objetos de outros registros e fabricantes). Os componentes do Kit possibilitam o acesso percutâneo com cânulas de acesso e cânulas para retiradas ósseas de acordo com a necessidade do cirurgião, tendo um controle preciso sobre a quantidade correta de osso a ser retirada, criando uma cavidade que será preenchida com biomateriais, posteriormente, via cânulas presentes no próprio kit descartável.

## Composição do Kit

2 Cânula de Acesso Pedicular

1 Fio Guia

2 Cânula de Acesso Vertebral

2 Ocluser Vertebral

1 Fresa Vertebral Canulada

2 Expansor para Osteoplastia Vertebral Somatic

2 Cânula para Injeção de Cimento

2 Empurrador de Cimento/Biomaterial

1 Pistola aplicadora de Cimento

1 Pote para Mistura de Cimento Ósseo

1 Espátula de Polímero para Mistura de Cimento Ósseo

1 Extensor



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO






# Kit Acesso Percutâneo Duo Plus

Registro Anvisa Nº. 82209529121

Kit fornece um instrumental para cirurgias minimamente invasivas indicado para pacientes com doenças degenerativas de disco, como hérnia de disco ou a protusão discal sintomática da região lombar. O kit visa a descompressão da raiz nervosa e o alívio da dor utilizando a técnica de discectomia

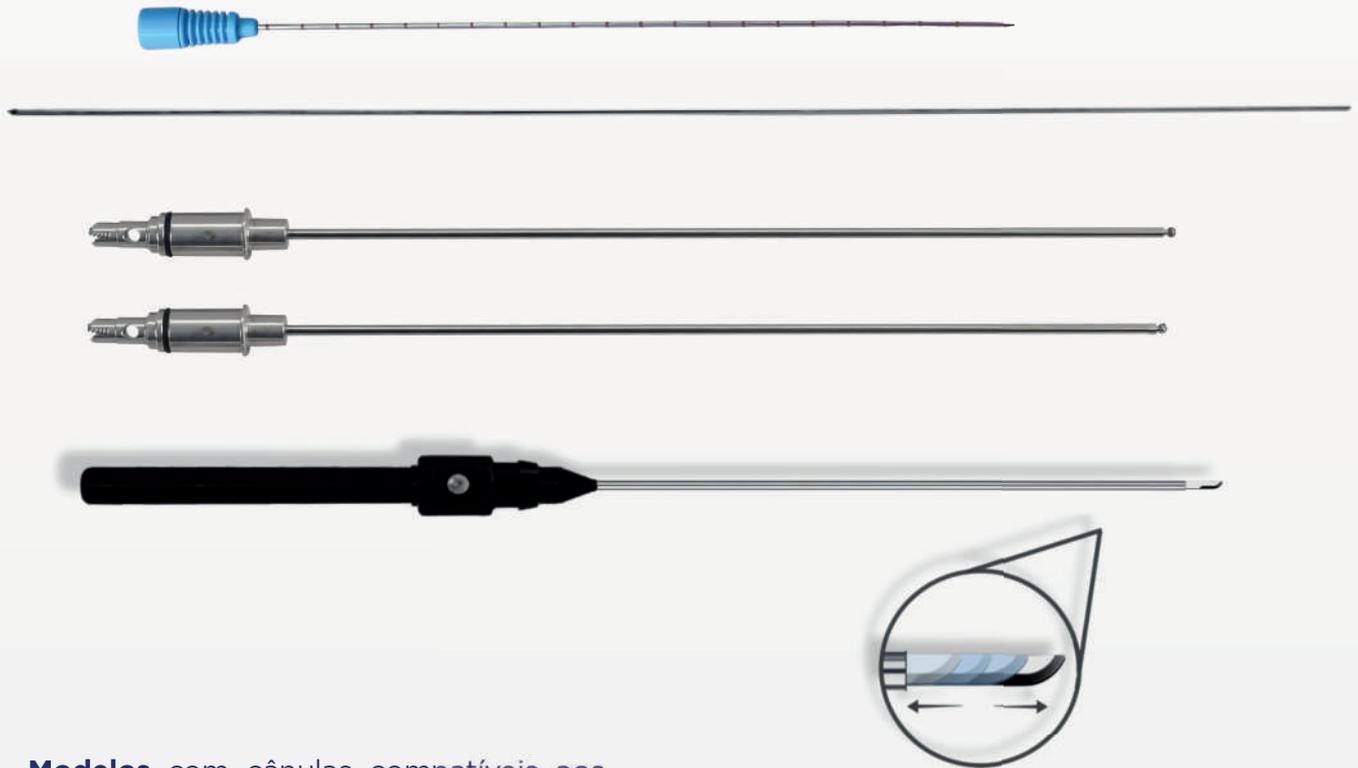

**Modelos** com cânulas compatíveis aos ncaixes Linvatec, Razek, Stryker, Formula, EP1 e Setormed.

## Composição do Kit KADP - 119 001

- 1 Estilete Retrátil 2,9mm x 330mm
- 1 Lâmina de Coluna BD 3,5 x 330 mm
- 1 Lâmina de Coluna BR 3,5 x 330 mm
- 1 Fio Guia 1mm x 400mm
- 1 Cânula de Punção 200mm x 18G



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cânula para Bloqueio e Viscosuplementação



Registro Anvisa N°. 82209529003

O kit é indicado nos procedimentos percutâneos de bloqueio analgésico e anestésico do nervo motor e ou sensitivo, com infiltração articular para tratamento de dores crônicas e agudas. Com auxílio de um equipamento ultrassom.



## Composição do Kit

- 1 Cânula 17 G x 90 mm
- 1 Cânula 21 G x 140 mm
- 1 Manifold
- 1 Cateter Extensor

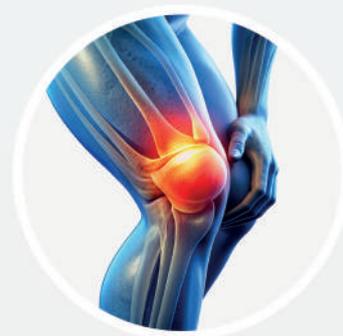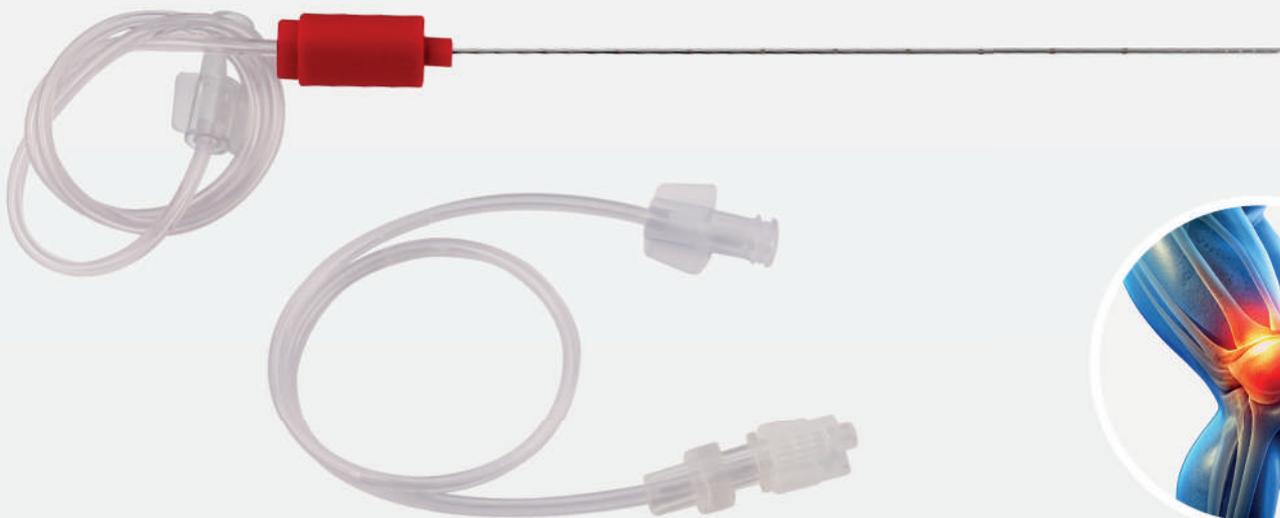

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO




# Kit Cãnula Para Bloqueio e Viscosuplementação Plus

Registro Anvisa N°. 82209529002

O kit é indicado nos procedimentos percutâneos de bloqueio analgésico e anestésico de nervo motor ou sensitivo, com o auxílio de ultrassom ou aparelho de neuroestimulação.




Possibilidade de Viscosuplementação

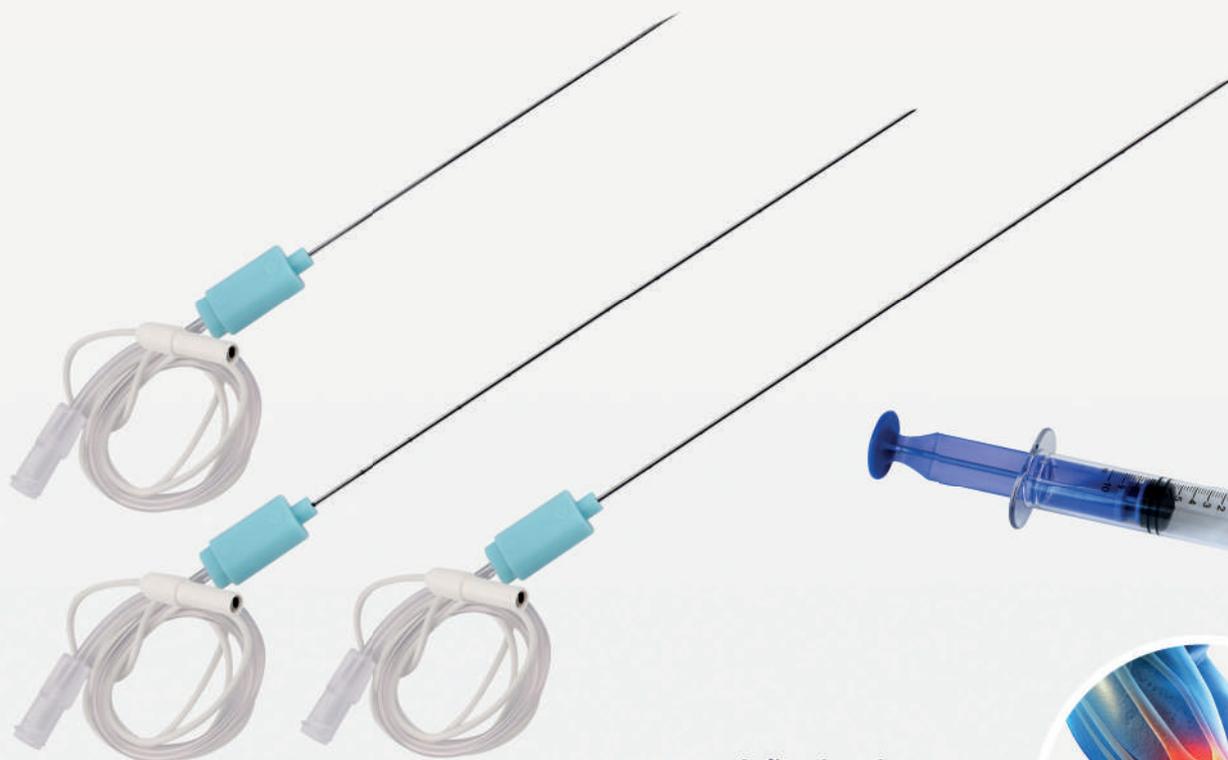

## Composição do Kit

- 1 Cãnula 21 G x 90 mm
- 1 Cãnula 21 G x 140 mm
- 1 Manifold
- 1 Cateter Extensor
- 1 Seringa

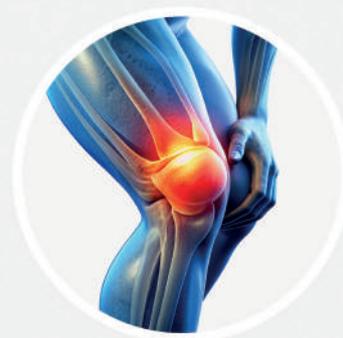

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Para Gerenciamento da Dor Viscosuplementação e Bioregeneração Bioregen

Registro Anvisa N°. 82209529140

Permite a coleta, manipulação e administração de fármacos, além de compostos autólogos regenerativos. Inclui cânulas com material flexível, com diâmetro que permite o fluxo de fármacos e substâncias viscoantálgicas regenerativas para procedimento de Bloqueio Neurolítico, Viscosuplementação e Bioregeneração do tratamento da dor e medicina do esporte. As cânulas possuem pontas ecoativas que melhoram a visualização no uso do ultrassom e oferecem deslizamento suave pelo músculo garantindo menor intensidade da dor durante o procedimento. Possui exclusiva Cânula de Aspiração de Medula Óssea possibilitando a coleta de material autólogo regenerativo para tratamento em diversas regiões do corpo.

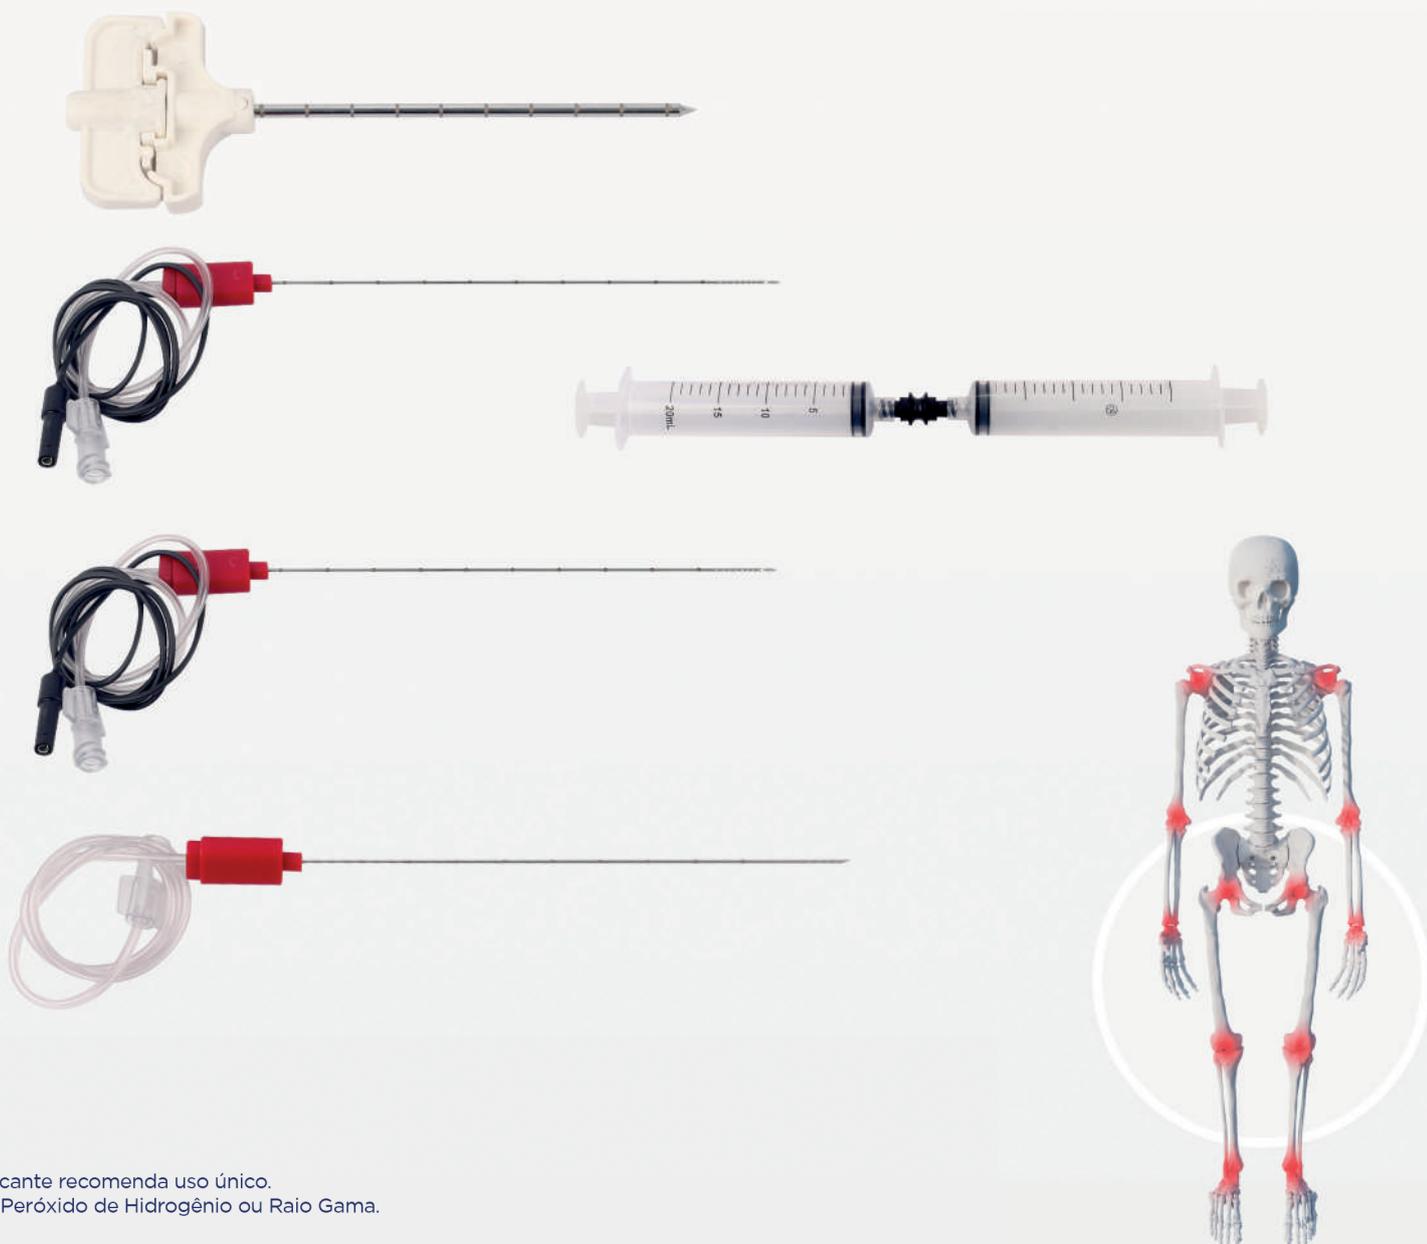

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit de Acesso Para Bloqueio

Registro Anvisa N°. 82209529066

Este kit se localiza por punção percutânea e por meio de exame de radiografia (Escopia), sendo para articulação da coluna vertebral, para a raiz nervosa e de quaisquer ossos articulados. Com permissão do auxílio do equipo é realizado de uma infiltração de soluções medicamentosas ou anestésicas.

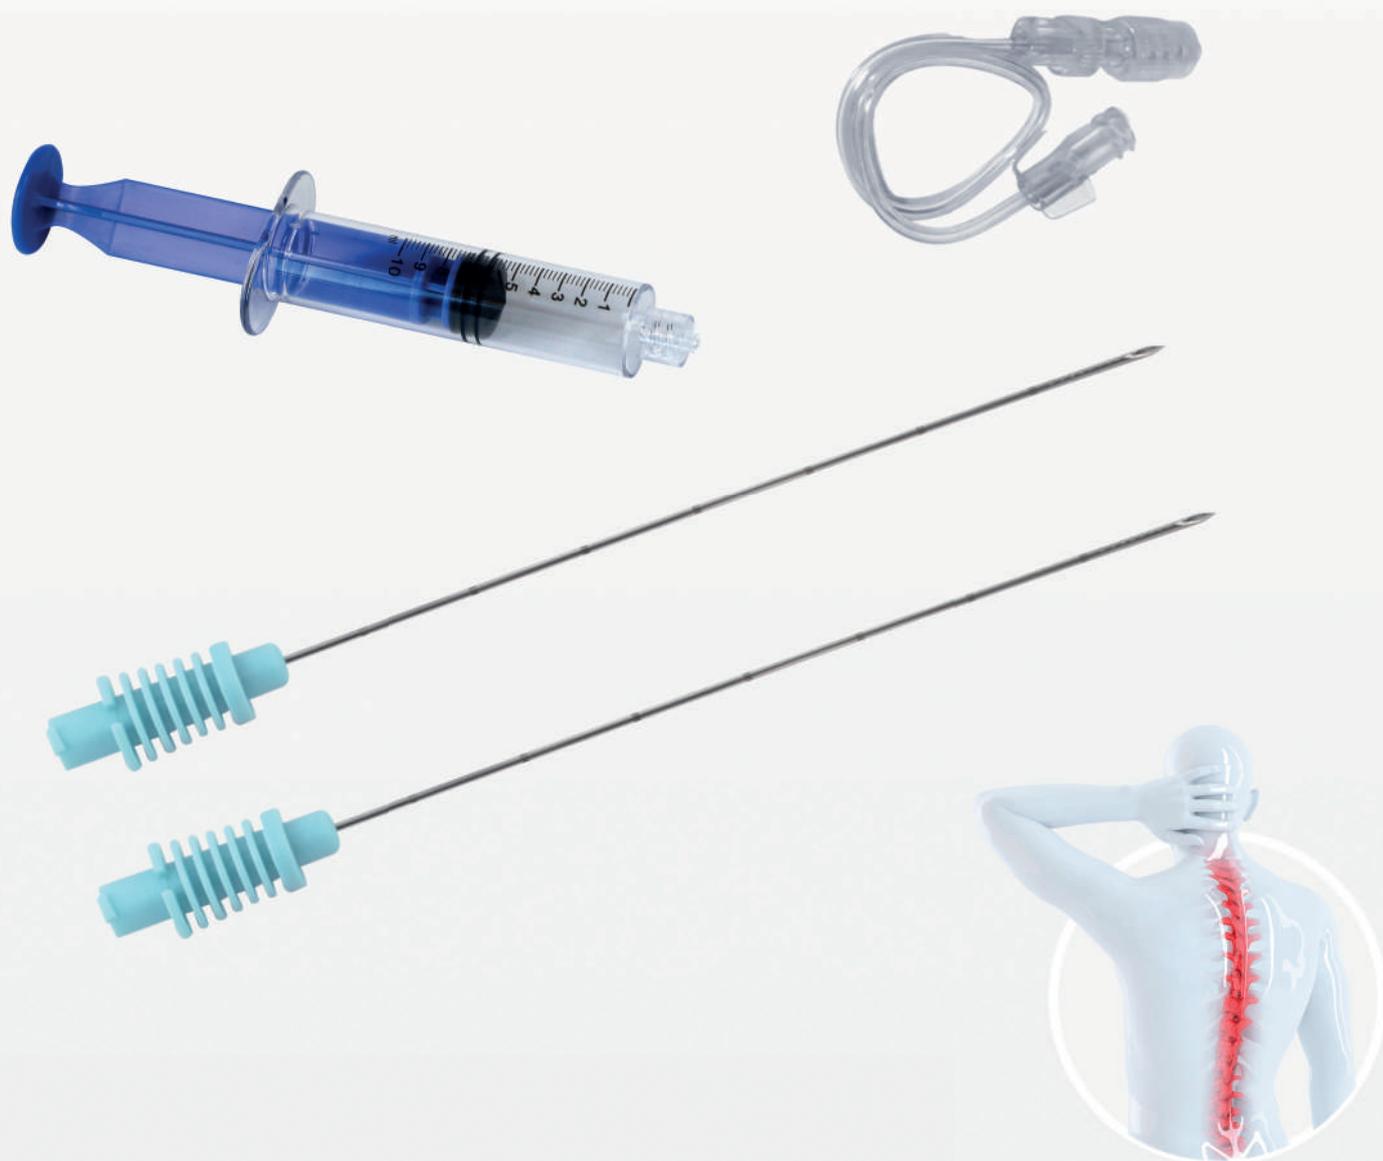

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)



ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit de Acesso para Bloqueio Com Estímulo

Este kit é indicado para realizar procedimentos de bloqueio do plexo e nervos periféricos, através da injeção de soluções anestésicas e de medicamentos utilizando uma estimulação elétrica para localizar o alvo. Agulha é introduzida no paciente com fluoroscopia ou ultrassom. Todo processo gera uma emulação motora no auxílio neuro estimulador.

Registro Anvisa N°. 82209529046

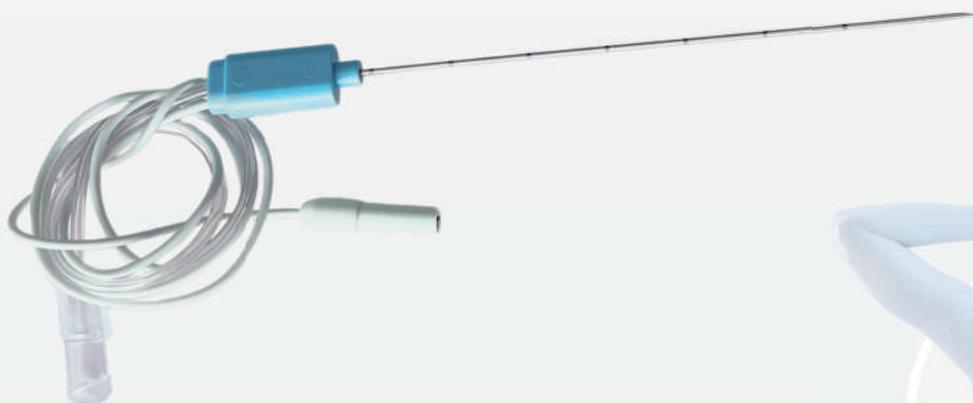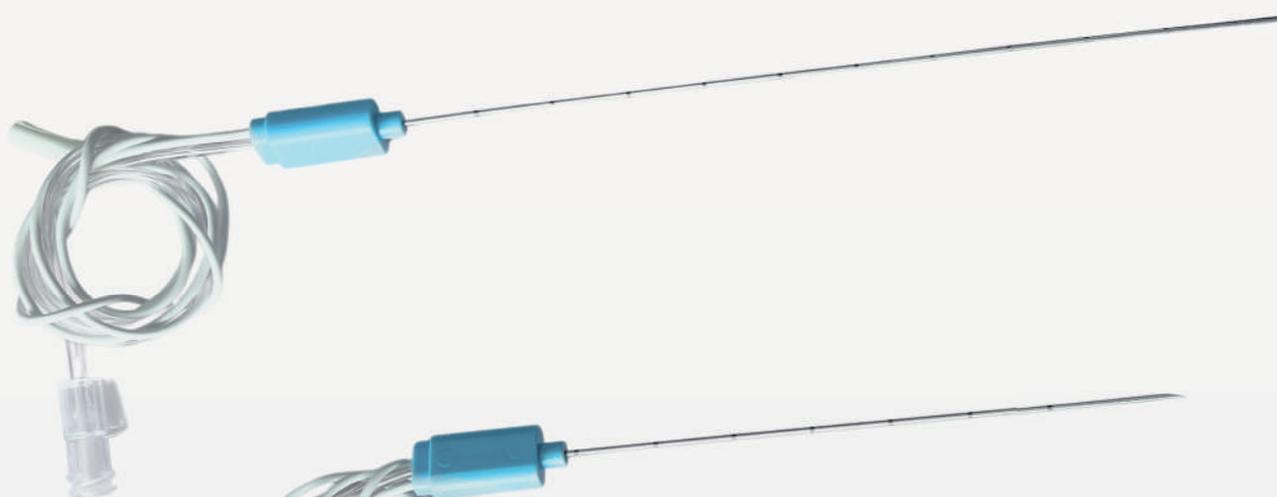

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO




# Cânula Híbrida Full Process

Registro Anvisa N°. 82209529090

Consiste em uma cânula com múltiplas funções possibilitando aplicação de fármacos, anestésicos e viscosuplementação. Pode ser utilizada como Cânula de Bloqueio com Estimulação, Cânula de Radiofrequência e Cânula Descartável Para Rizotomia. Possui ponta ecogênica com diversos tamanhos de pontas ativas, diâmetros (Gauges) diversos e várias medidas, que possibilitam aplicações em vários procedimentos clínicos. (Produto Exclusivo Marden)

*Bloqueio e Rizotomia*

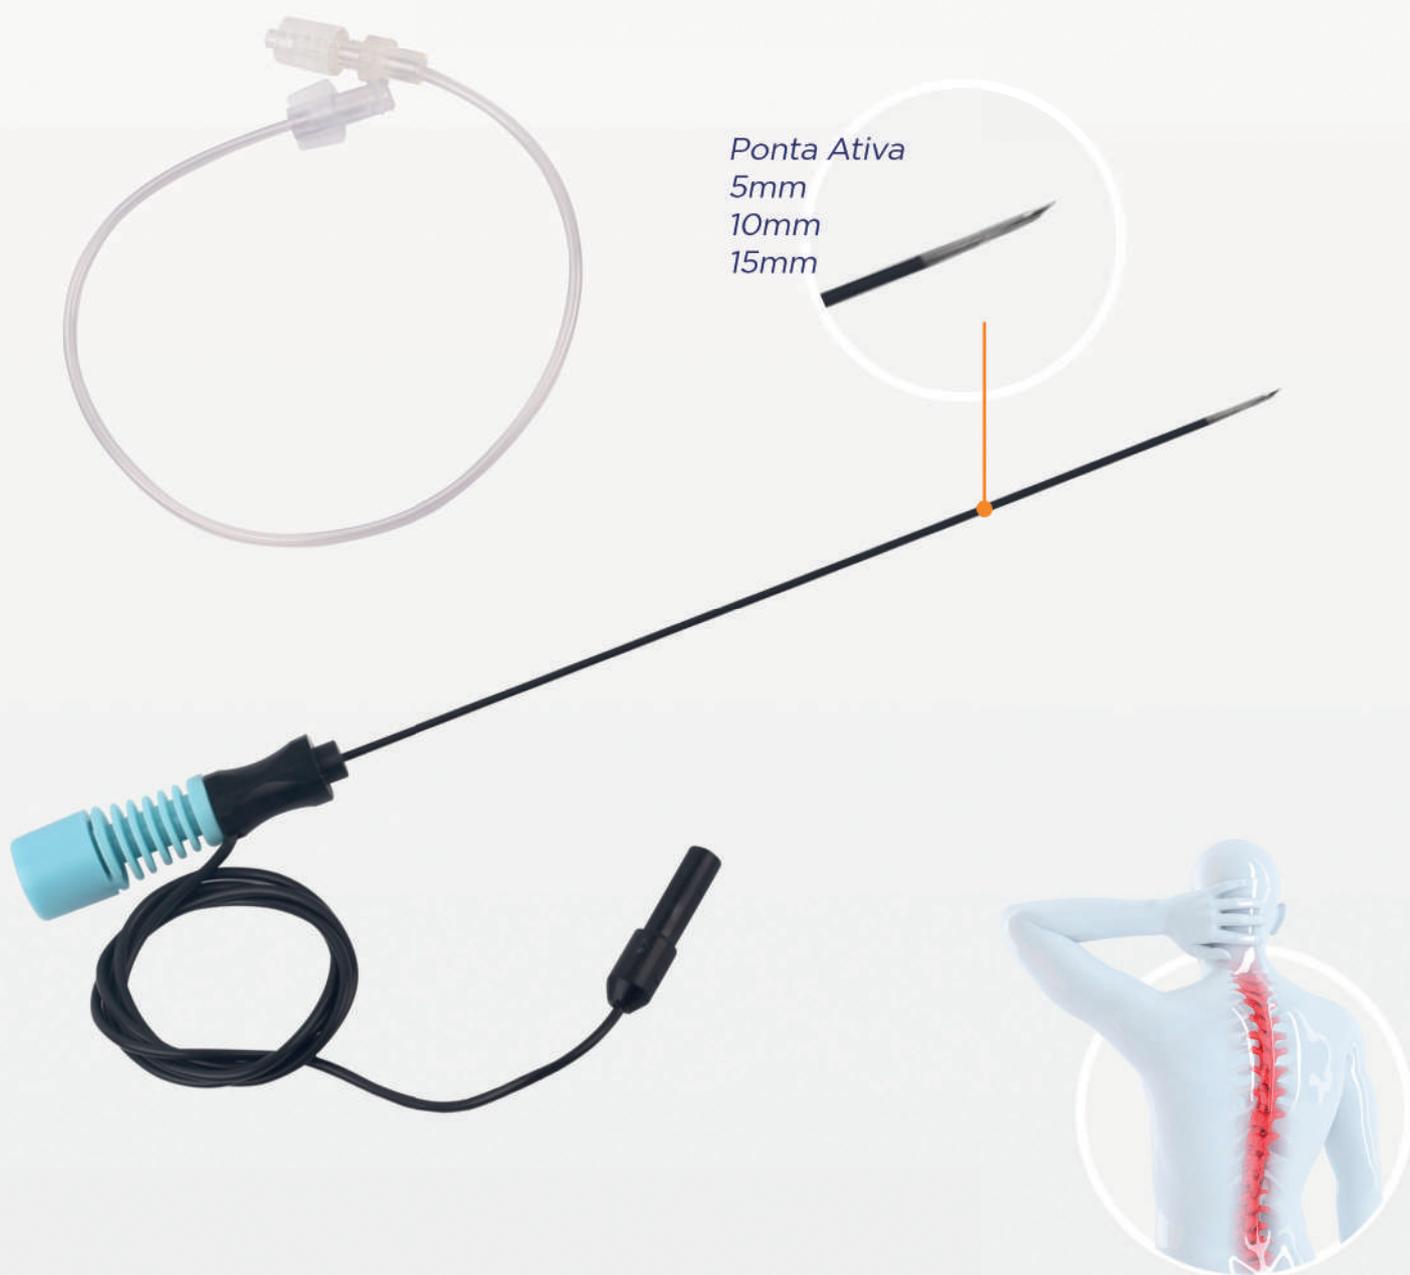

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Cânula Descartável Para Rizotomia

Registro Anvisa N°. 82209529010

Esta cânula foi desenvolvida para ser utilizada como guia durante a passagem de ponteira descartável em procedimentos cirúrgicos de Rizotomia. O objetivo principal é atingir o alvo desejado direcionado aos procedimentos cirúrgicos.

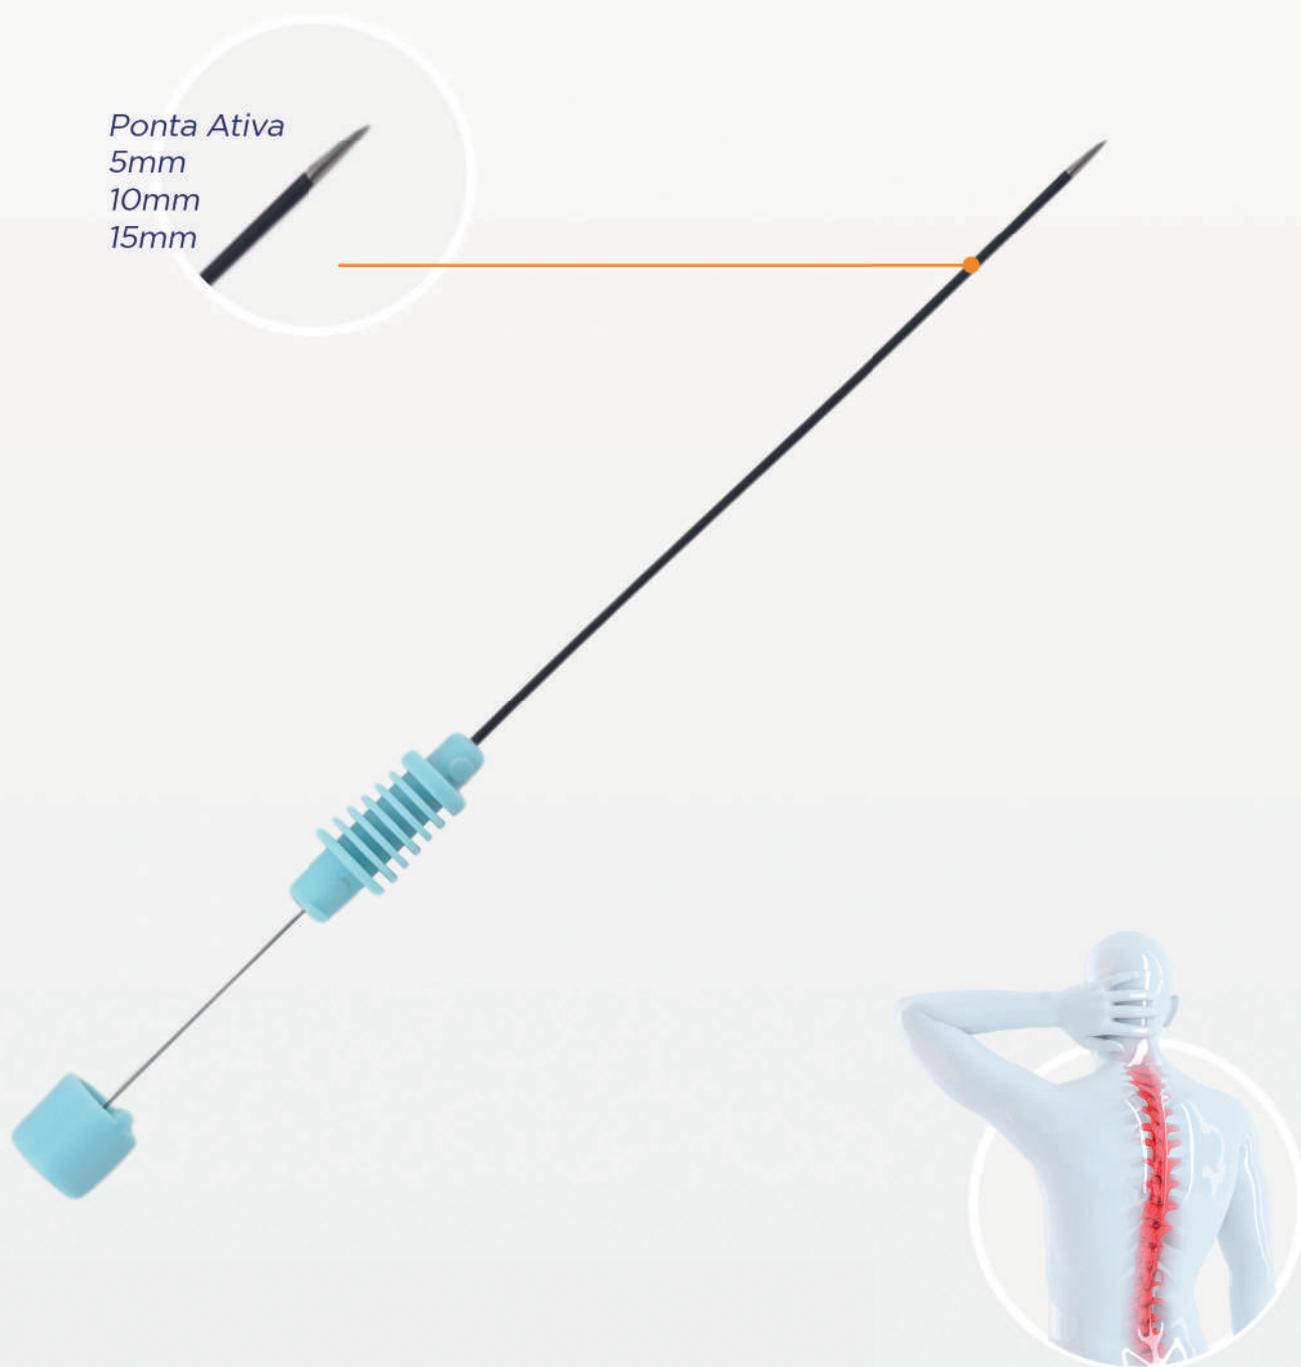

Ponta Ativa  
5mm  
10mm  
15mm

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Cânula para bloqueio com estímulo Marden

Registro Anvisa N°. 82209529001

A Cânula para Bloqueio com Estímulo Marden é indicado para realizar procedimentos de bloqueio do plexo e nervos periféricos através da injeção de soluções anestésicas/medicamentos (objeto de outro registro) utilizando estimulação elétrica para localização do alvo. A estimulação é feita através de qualquer modelo de estimulador de baixa frequência, sendo este, objeto de outro registro. A Cânula é introduzida no paciente e sua localização é determinada através do uso de fluoroscopia, ultrassom ou raio-x e através da estimulação elétrica gera estimulação motora a fim de confirmar a localização do plexo, ou nervos periféricos, possibilitando a realização de bloqueio através da injeção de fluidos anestésicos/medicamentos.



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Cânula Para Bloqueio

Registro Anvisa N°. 82209529006

Esta cânula é indicada para realizar procedimentos de bloqueio do plexo e nervos periféricos por meio da injeção de soluções anestésicas. O bloqueio consiste em interromper os impulsos sensoriais de uma região do corpo, diminuindo ou até eliminando por completo a dor.



## Modelos

21 G x (50, 70, 80, 90, 100, 120 e 150 mm)

22 G x (50, 70, 80, 100, 120 e 150 mm)

23 G x (50, 70 e 100 mm)



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Cânula de Debridação de Coluna Protection

Registro Anvisa N°. 82209529250

As Cânulas de Debridação para Coluna Protection Marden são utilizadas em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivo nas regiões do Coluna. Os princípios de funcionamento da Cânula de Debridação para Coluna Protection Marden são o corte e sucção de tecidos. A parte interna chamada de cânula de corte e sucção realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente. O recobrimento de teflon ao longo da cânula externa, proporciona uma melhor penetração no local da incisão cirúrgica, além de proteger de eventuais acidentes cirúrgicos. O teflon existente na cânula externa é radiopaco, que ainda permite uma visualização otimizada da cânula via endoscopia ou ultrassom, permitindo ao cirurgião uma melhoria da precisão cirúrgica.

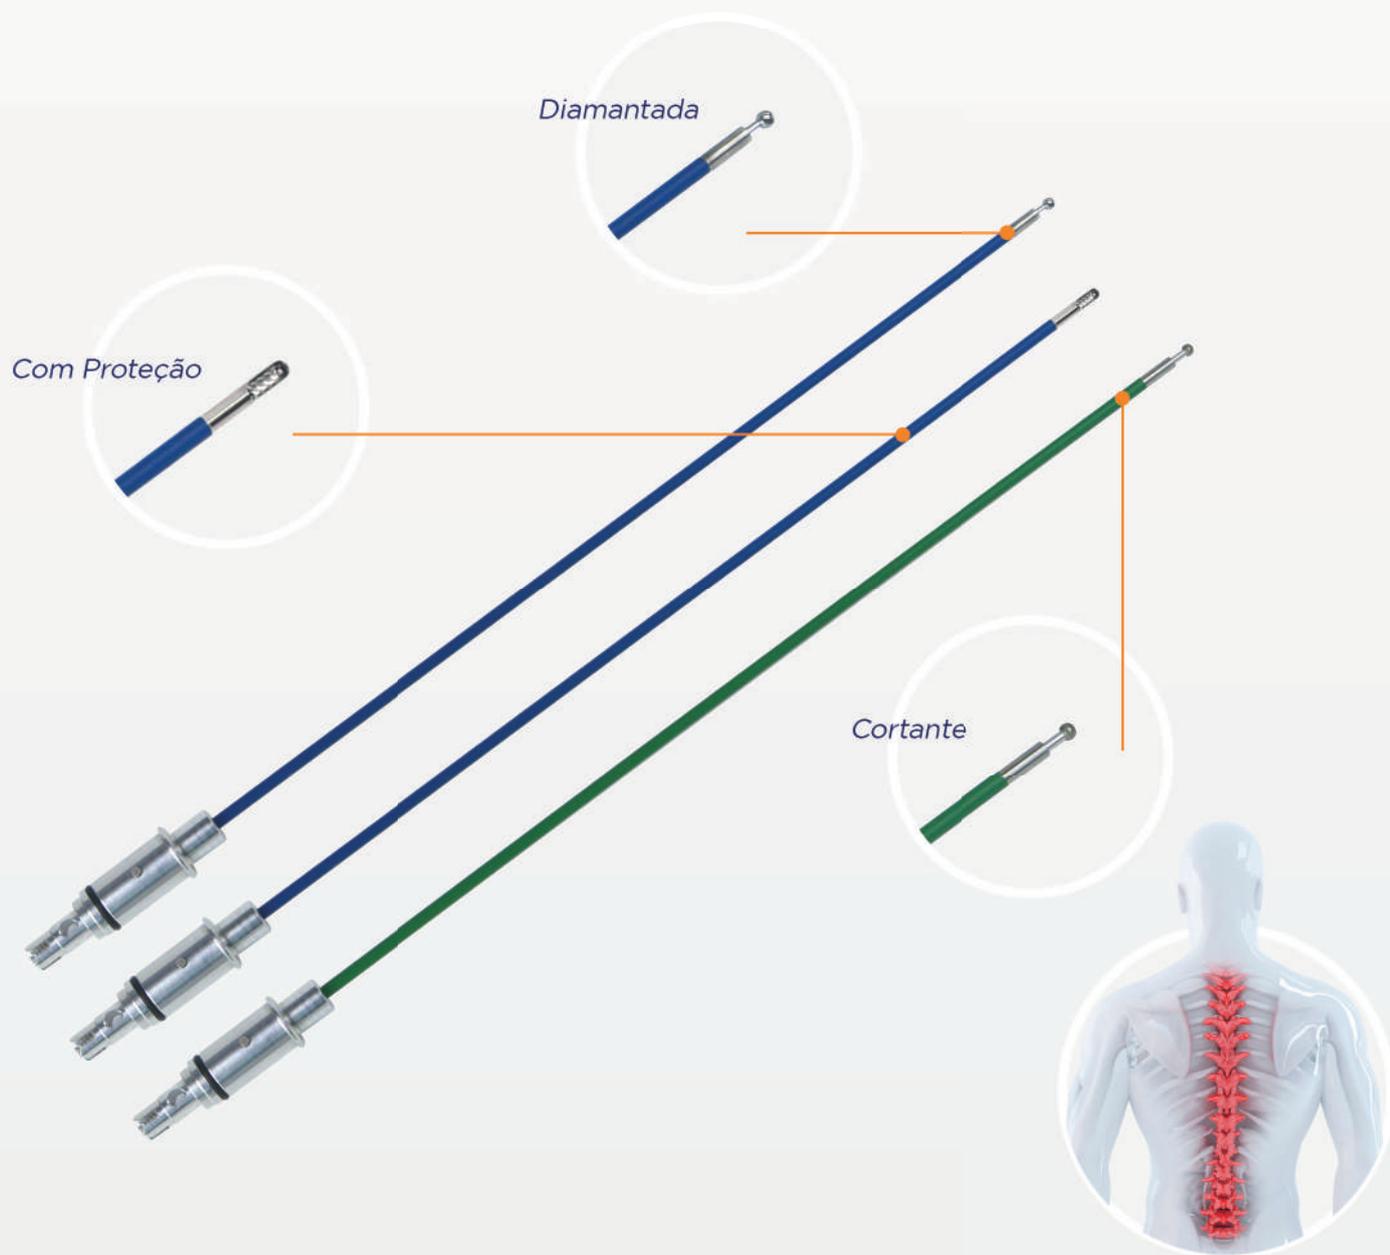

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Cânula de Debridação Para Coluna Plus TGT

Registro Anvisa N°. 82209520016

Este produto foi desenvolvido para ser utilizado juntamente com os aparelhos de Shaver, sendo compatíveis com encaixes: Linvatec, Razek, Stryker Fórmula, EPI e Setormed. Voltando para procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos na coluna, este material é indicado para raspar, debridar e retirar os excessos de tecidos ósseos. É composto por uma cânula guia (externa), uma cânula de corte e sucção (interna) e encaixe traseiro.

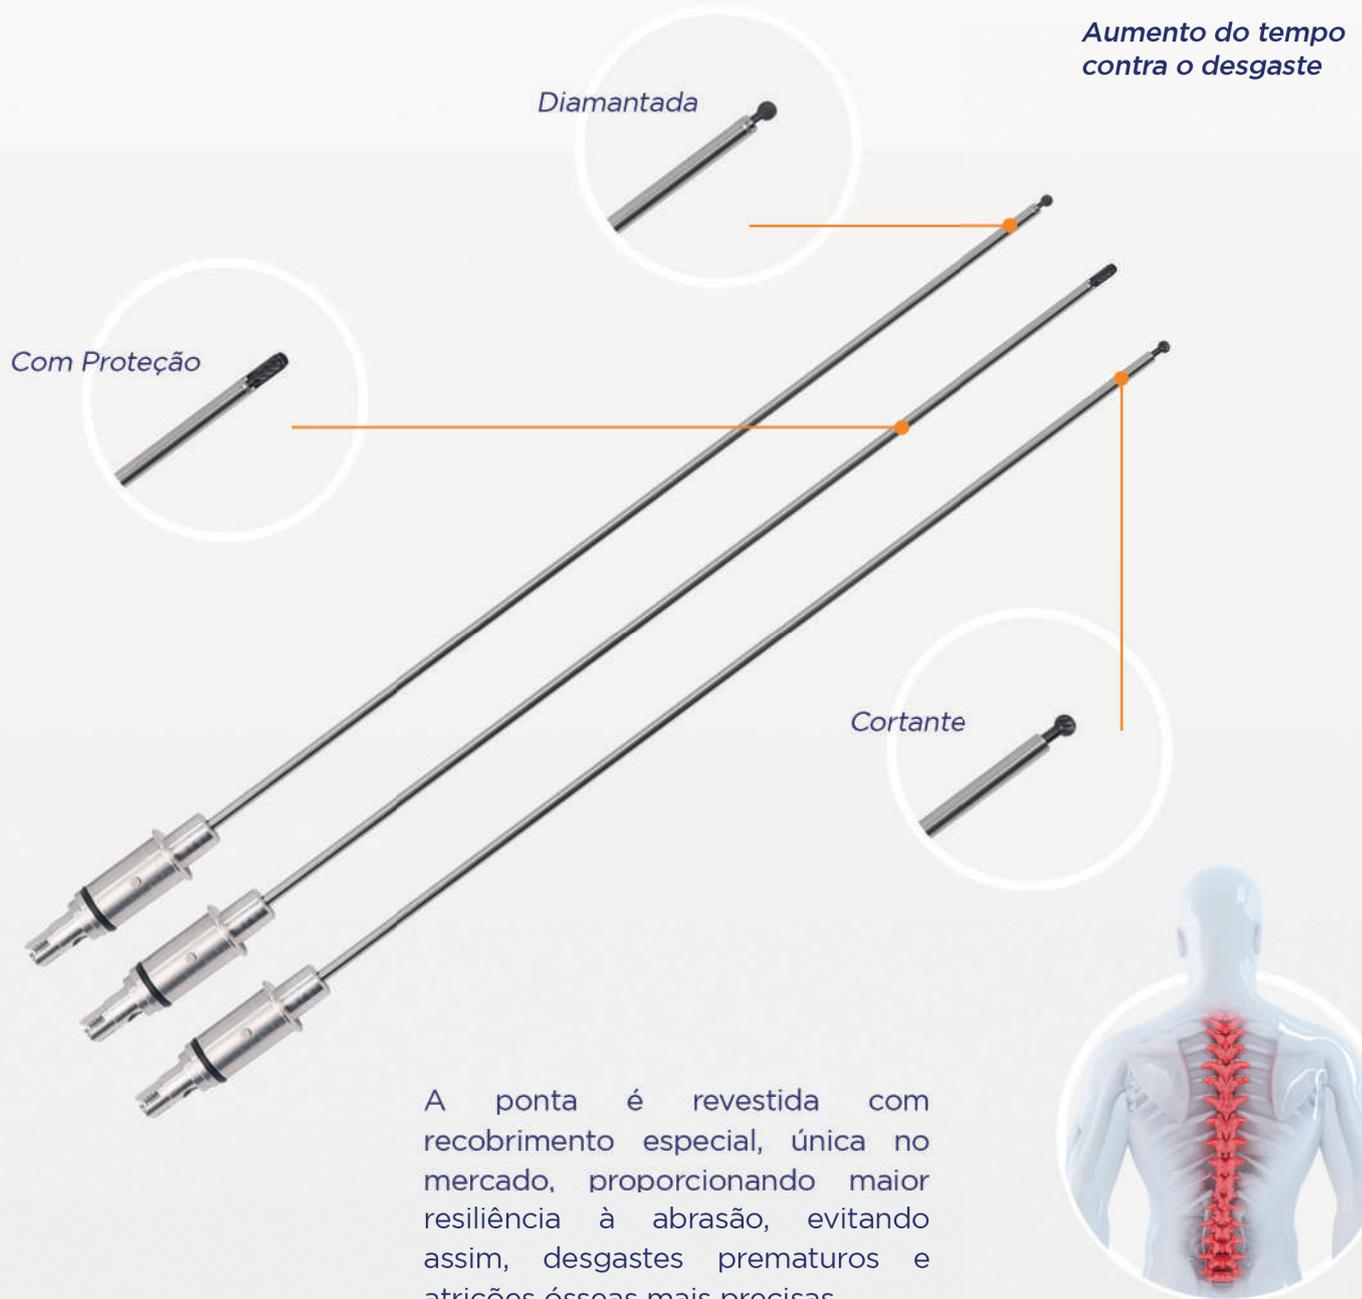

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Cânula de Debridação Para Coluna

Registro Anvisa N°. 82209529011

Esta cânula é utilizada em procedimentos cirúrgicos minimamente invasivos nas regiões da coluna. Indicada para perfurar, raspar, moer e retirar excessos de tecidos ósseos e cartilagosos. Realiza o corte e a sucção dos tecidos simultaneamente.

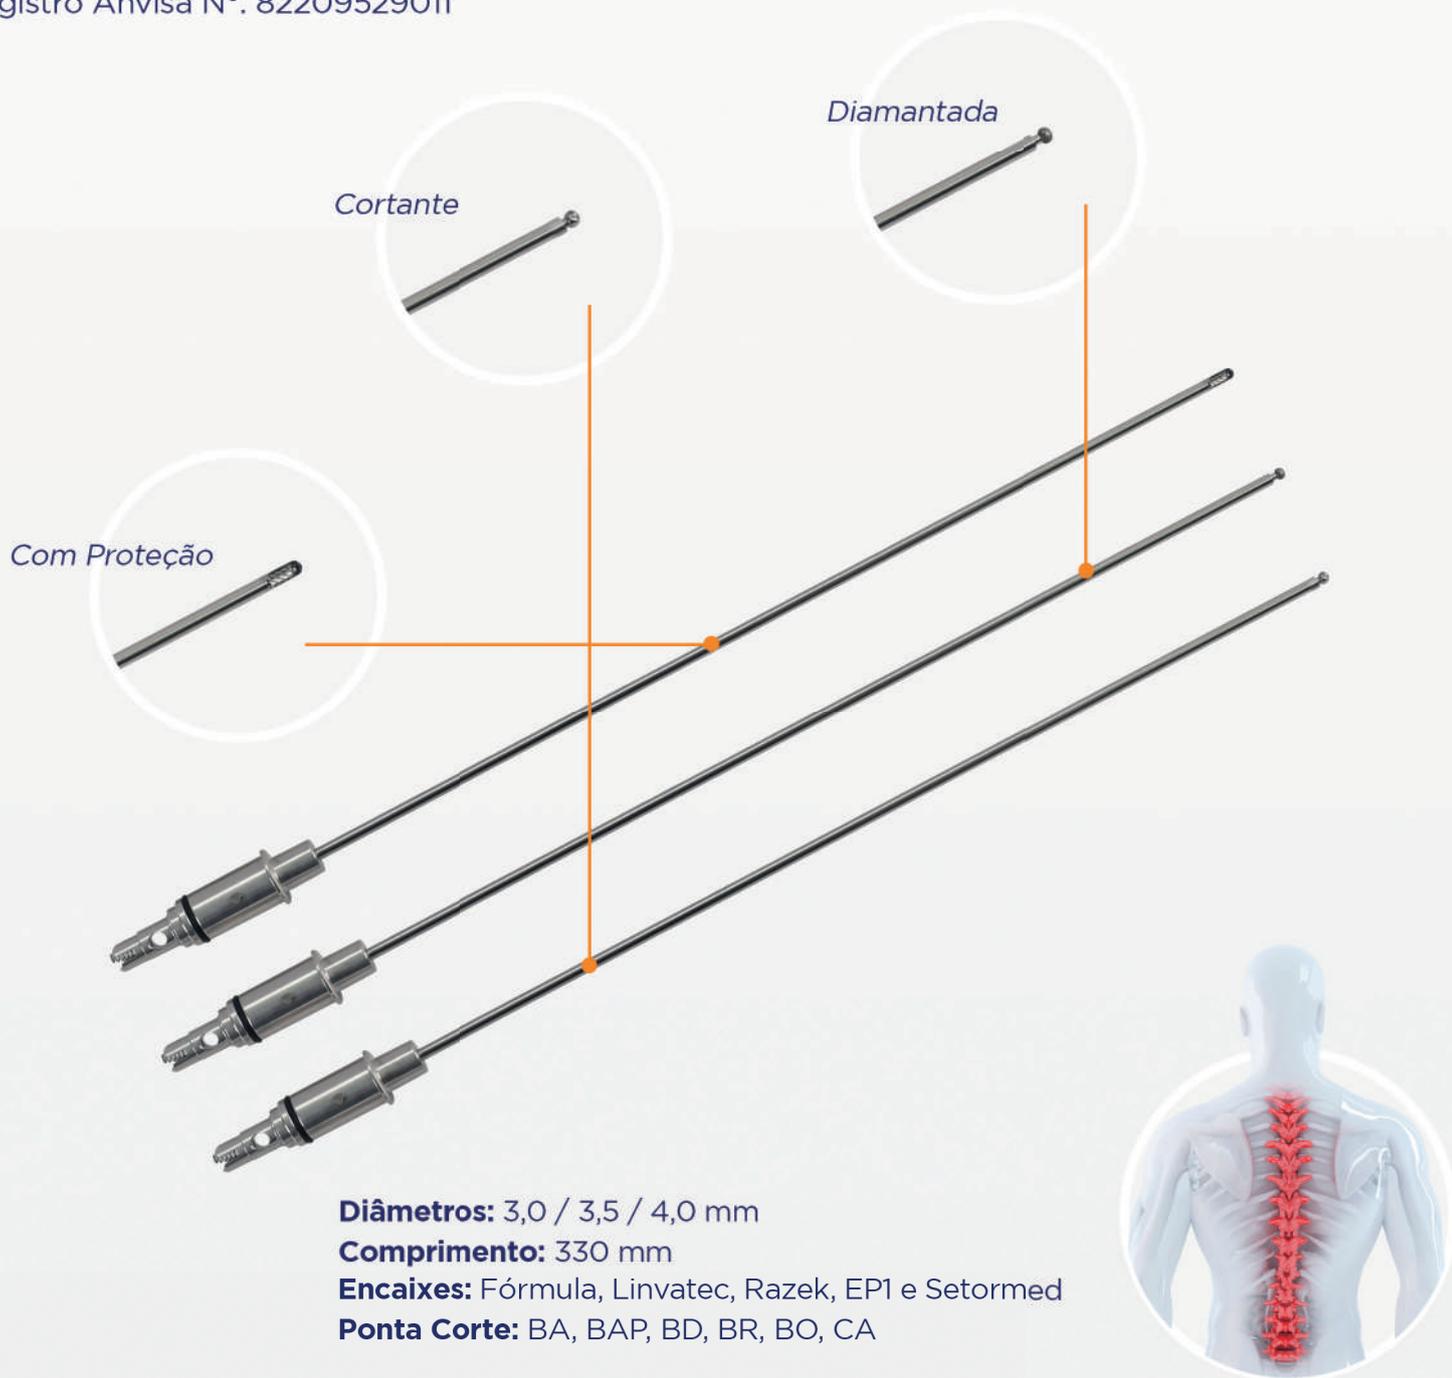

**Diâmetros:** 3,0 / 3,5 / 4,0 mm

**Comprimento:** 330 mm

**Encaixes:** Fórmula, Linvatec, Razek, EP1 e Setormed

**Ponta Corte:** BA, BAP, BD, BR, BO, CA

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Equipo de Irrigação

Registro Anvisa N°. 82209529007

Utilizado em conjunto com um equipamento de Bomba de Irrigação. Sua finalidade visa manter um fluxo irrigação contínuo e sua ação é irrigar (fazendo expandir) com solução fisiológica a articulação a ser submetido à Artroscopia, seja para tratamento de patologias ou para diagnósticos, possibilitando uma melhor visualização. O soro fisiológico infunde por ação da bomba de irrigação.



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Equipo Ultrassônico

Registro Anvisa N°. 82209529215

O Equipo de Aspiração e Irrigação Ultrassônico Marden é indicado em cirurgias minimamente invasivas para o uso com equipamentos de aspiração/irrigação ultrassônicos (objeto de outro registro) de uso cirúrgico para conduzir fluido irrigador para o local de intervenção cirúrgica, bem conduzir fluido aspirado do local. Serve cirurgia geral, descartáveis, neuro/ortopedia, otn/cabeça e pescoço e neuro.



Compatível com **Stryker e Sonoca**

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO




# Kit de Cirurgia para Discografia

Registro Anvisa N°. 82209529004

O kit é utilizado durante o procedimento de discografia provocativa para aliviar a pressão dos disco intervertebral. Indicado em procedimento para detecção e diagnóstico de dores crônicas, doenças degenerativas e danos estruturais nos discos intervertebrais da coluna vertebral.

## Composição do Kit MD1

- 1 Insuflador com Monômetro Digital
- 1 Conector de 3 vias
- 1 Agulha 18 G x 90 mm
- 1 Agulha 20 G x 90 mm
- 1 Agulha 22 G x 90 mm

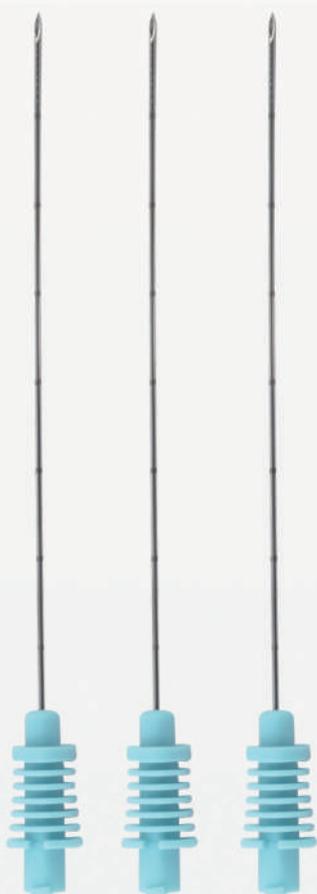

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO




# Kit Neuroendoscópio Endonav

Registro Anvisa N°. 82209529114

O Kit ENDONAV Marden é um conjunto de instrumentos seguro e eficaz, que possibilita o cirurgião acessar e tratar com eficiência distúrbios da Hipófise por via Transesfenoidal endoscópica, com o intuito de causar mínimo dano às demais estruturas da anatomia, sendo portanto, uma solução minimamente invasiva para este tipo de tratamento. O Kit ENDONAV Marden é utilizado sob visualização de um endoscópio a fim de tratar as patologias da glândula Hipófise permitindo o acesso e execução do tratamento de forma minimamente invasiva, com uso de um endoscópio.

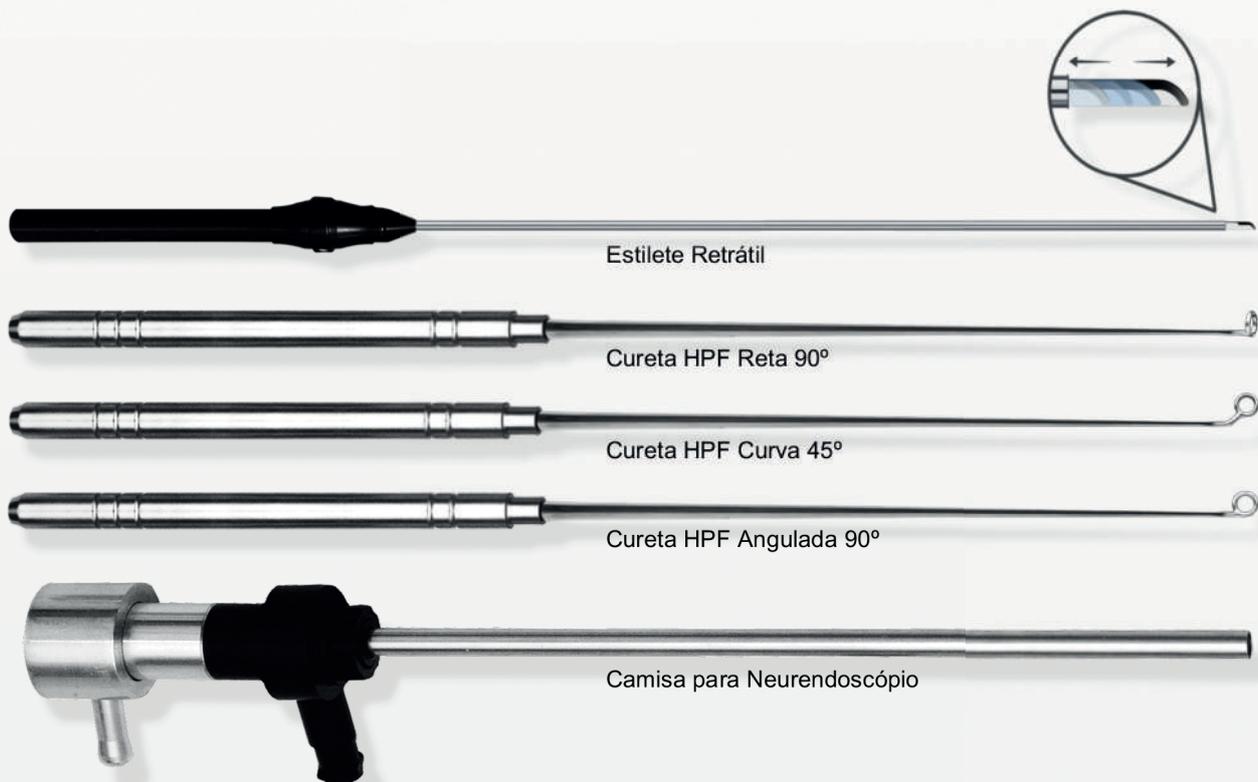

KHTE 086 001 – KIT ENDONAV	
01	CURETA HPF RETA 90°
01	CURETA HPF CURVA 45°
01	CURETA HPF ANGULADA 90°
01	ESTILETE RETRÁTIL
01	CAMISA PARA NEUROENDOSCÓPIO

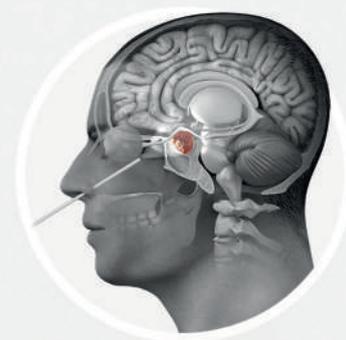

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)


ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Neuroendoscópio Endovent 4Fr

Registro Anvisa N°. 82209529106

O Kit ENDOVENT 4Fr Marden é um conjunto de instrumentos seguro e eficaz, que possibilita o cirurgião acessar e tratar com eficiência distúrbios das estruturas neurais intracranianas por via endoscópica, com o intuito de causar mínimo dano às demais estruturas da anatomia, sendo, portanto, uma solução minimamente invasiva para este tipo de tratamento. O Kit ENDOVENT 4Fr Marden é utilizado sob visualização de um endoscópio a fim de tratar as patologias ventriculares permitindo o acesso e execução de tratamentos endoscópicos intracranianos de patologias como: 3º Ventriculostomia e Septostomia Endoscópica para manejo da hidrocefalia, Ressecção de Cistos Aracnoideos, ressecção de Cisto Coloide Intraventricular.

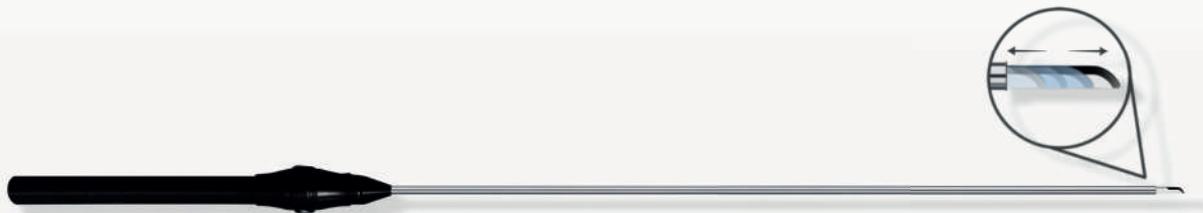

**Estilete Retrátil**



**Cateter Balão 4Fr tipo Fogarty**



**Seringa Insulfladora**



**Camisa para Neuroendoscópio**

01	CATETER BALÃO TIPO FOGARTY 4FR
01	ESTILETE RETRÁTIL
01	SERINGA INSULFLADORA
01	CAMISA PARA NEUROENDOSCÓPIO



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O N O V O D E N O V O

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO





# Kit Neuronav Ctx 3Fr

Registro Anvisa N°. 82209529154

01	CATETER BALÃO TIPO FOGARTY 3FR
01	ESTILETE RETRÁTIL
01	MICRO ESPATULA
01	CURETA RETA 90°
01	CURETA ANGULADA 90°
01	CURETA CURVA 90°
01	CAMISA PARA ENDOSCÓPIO 185MM 0°

O Kit NEURONAV Ctx 3Fr Marden é um conjunto de instrumentos seguro e eficaz, que possibilita o cirurgião acessar e tratar com eficiência distúrbios das estruturas neurais intracranianas por via endoscópica, com o intuito de causar mínimo dano às demais estruturas da anatomia, sendo portanto, uma solução minimamente invasiva para este tipo de tratamento. NEURONAV Ctx 3Fr Marden é utilizado sob visualização de um endoscópio a fim de tratar as patologias ventriculares permitindo o acesso e execução de tratamentos endoscópicos intracranianos de patologias como: 3º Ventriculostomia e Septostomia Endoscópica para manejo da hidrocefalia, Ressecção de Cistos Aracnoideos, ressecção de Cisto Coloide Intraventricular.

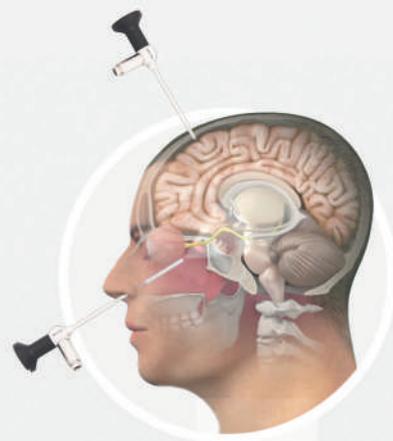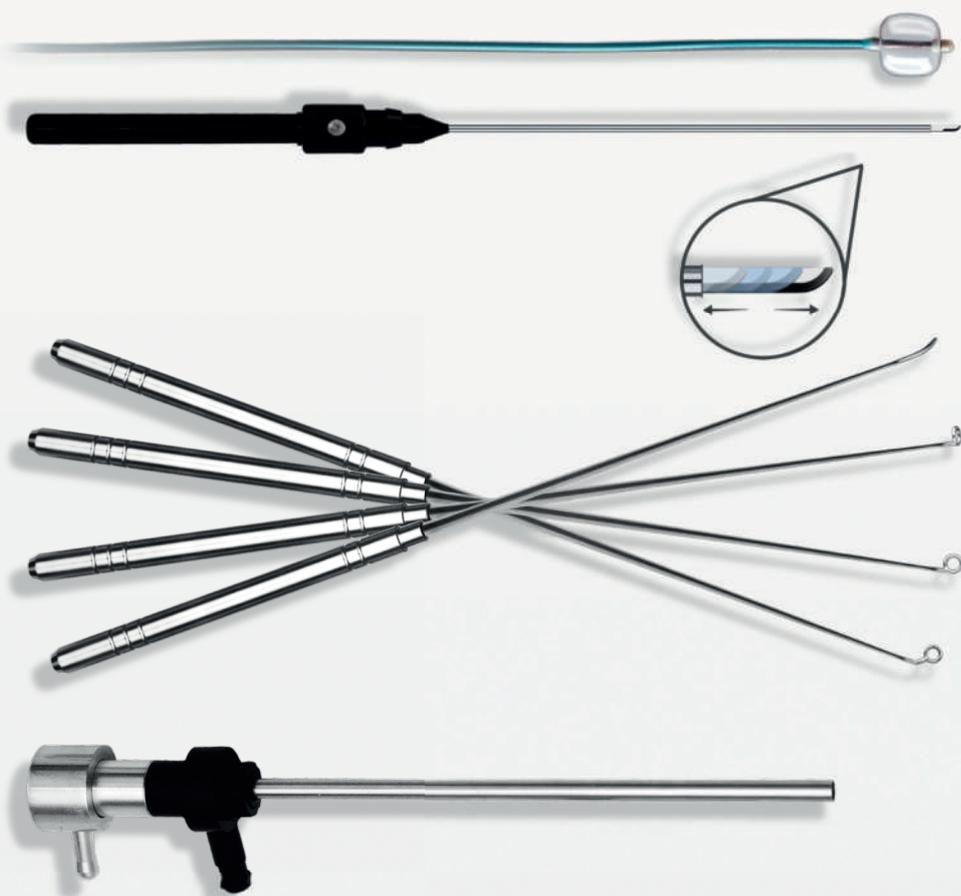

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO



# Kit Cânula RetroBlade

Registro Anvisa N°. 82209529307

O Kit Cânula RetroBlade é indicado para procedimentos de liberação de túneis osteofibrosos, fasciotomias, neurólises, tenólises, transposição de nervos, transferências musculares e tendinosas e descompressão de nervos. Atende a uma variedade de procedimentos, tais como; em cirurgias de mão, punho, cotovelo, joelho, quadril, pé e tornozelo.

Detalhe do Corte



Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEIE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO




# Pinça de Discectomia Descartável

Registro Anvisa N°. 82209529139

Instrumento cirúrgico desenvolvido para auxiliar nas cirurgias de Discectomia. Indicada para procedimentos que necessitam de manipulação intra-articular, de corte de tecidos, suporte e auxílio em sutura, antes mesmo da retirada dos corpos estranhos. A partir da escolha de um modelo correto e acionamento mecânico do gatilho, o cirurgião controla toda a ação motora deste produto.

Código	Descrição
PIDM – 091 001	Pinça de Discectomia 2,5 x 220 mm
PIDM – 091 002	Pinça de Discectomia 2,5 x 330 mm

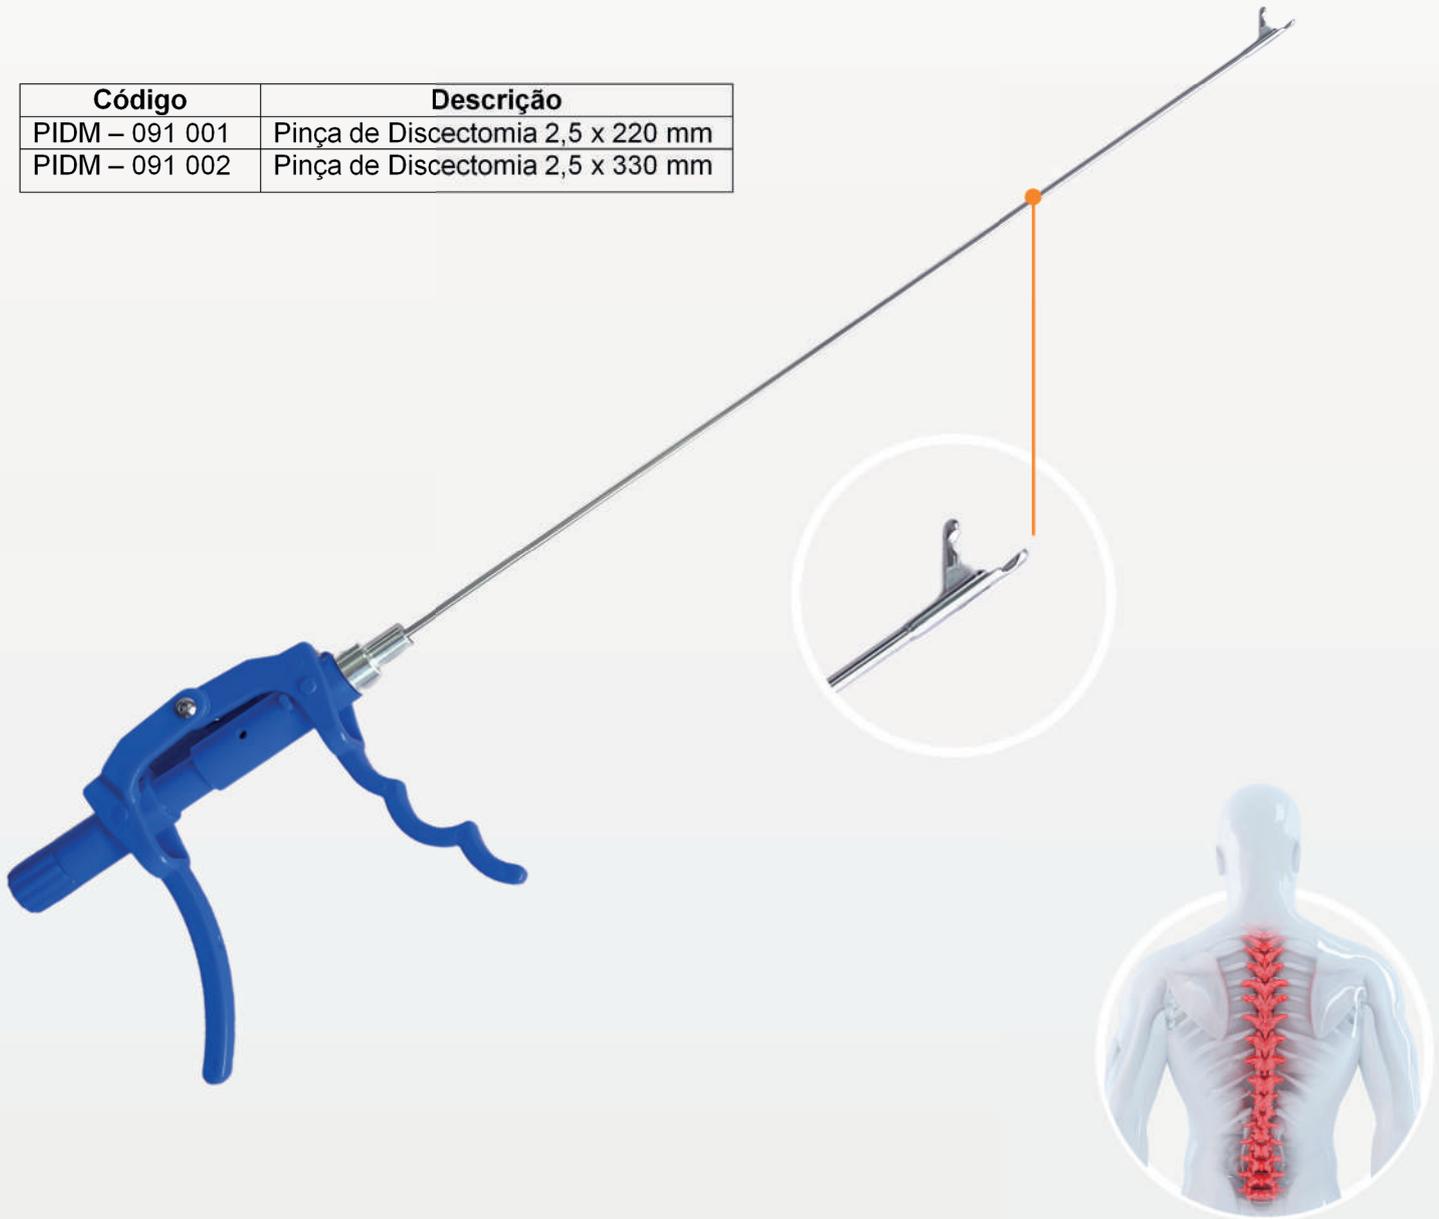

Fabricante recomenda uso único.  
ETO, Peróxido de Hidrogênio ou Raio Gama.

**Marden Medical**  
O NOVO DE NOVO

[www.mardenmedical.com.br](http://www.mardenmedical.com.br)

ESCANEE O QR CODE  
E SAIBA MAIS SOBRE  
ESTE PRODUTO

